


MEDVIE


Date du test: 15/05/2025 12:11:52
Durée: 4mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO SEKOU
Date de naissance	04/04/2001
Age	24
Société	CR18
ID	25051512054105855

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

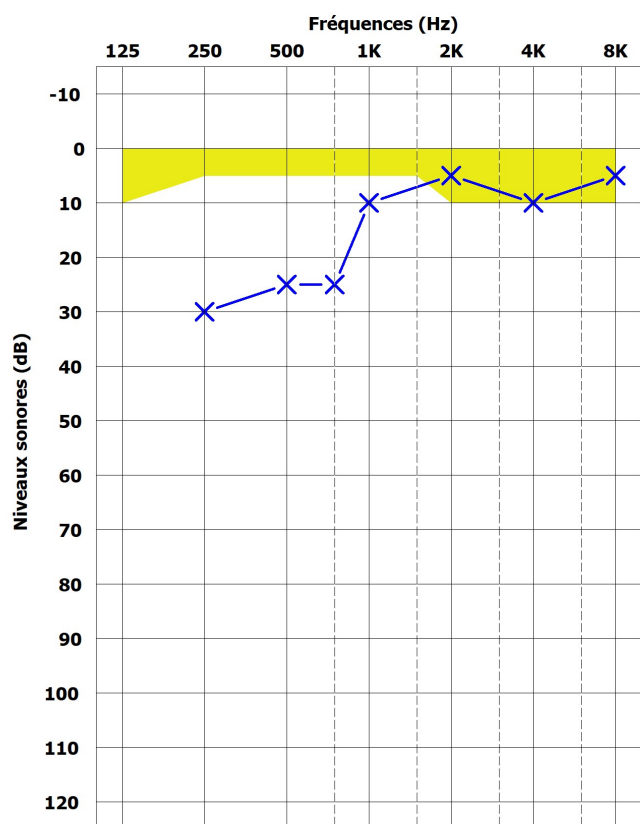

Oreille Gauche

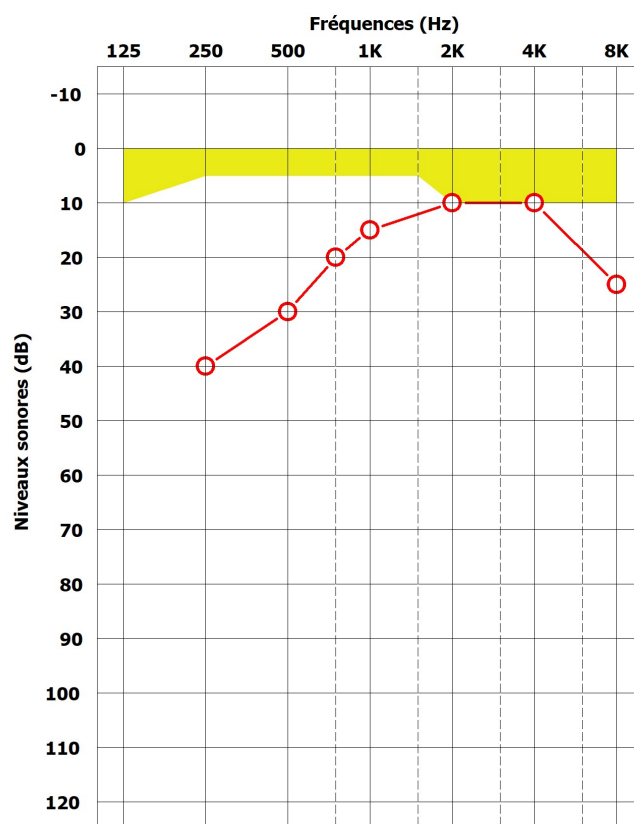

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	10		5		10		5
CA Droit		40	30	20	15		10		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes