

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:12:33

Durée: 5mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA MAMOUDOU
Date de naissance	23/09/2005
Age	19
Société	CR18
ID	25031412552219796

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

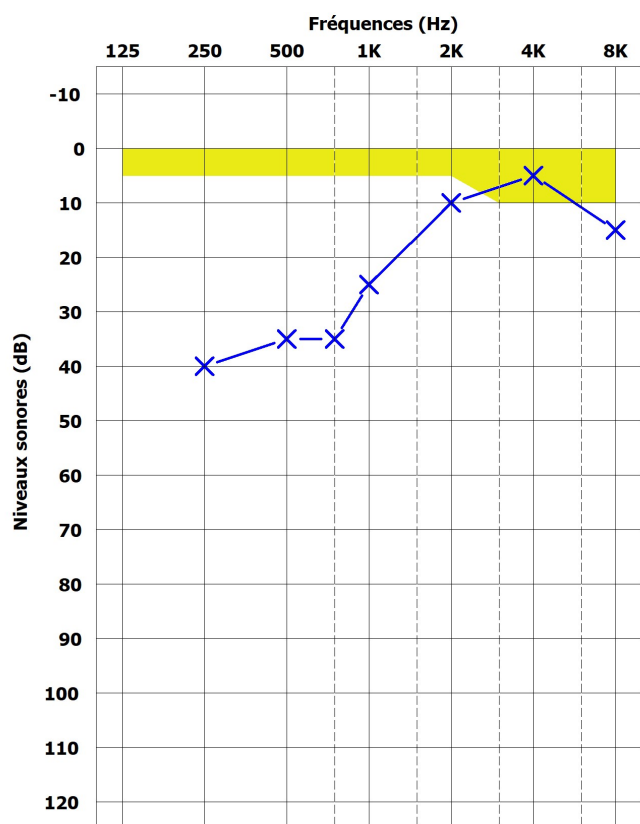

Oreille Gauche

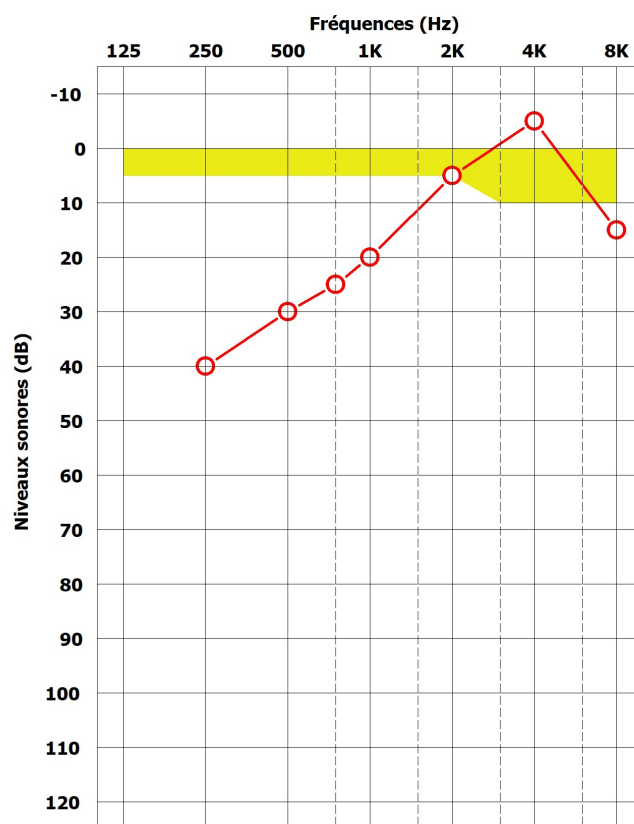

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	35	35	25		10		5		15
CA Droit		40	30	25	20		5		-5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes