

Données Patient

TRAORE AMARA

Date de naissance

01/01/1985

Age

39

Société

CR18

ID

24050513541448916

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 05/05/2024 13:57:47


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

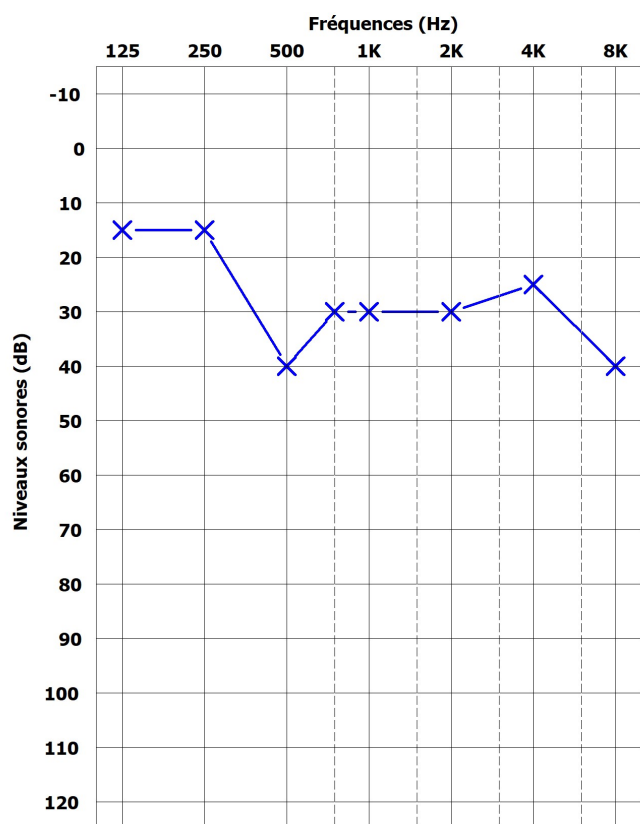

Oreille Gauche

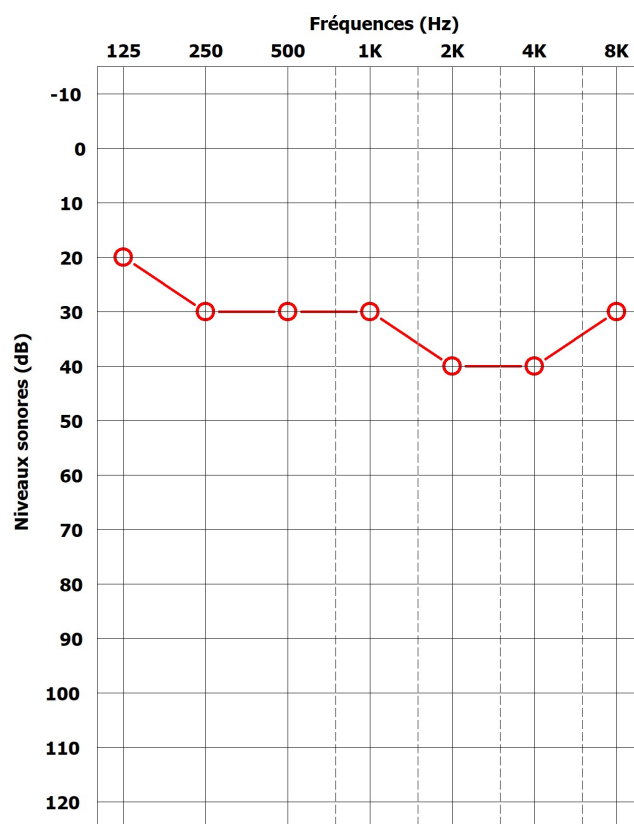

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	40	30	30		30		25		40
CA Droit	20	30	30		30		40		40		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	35,0 dB	---

Notes