


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 14:47:48
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	DIABATE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24053114433240227

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

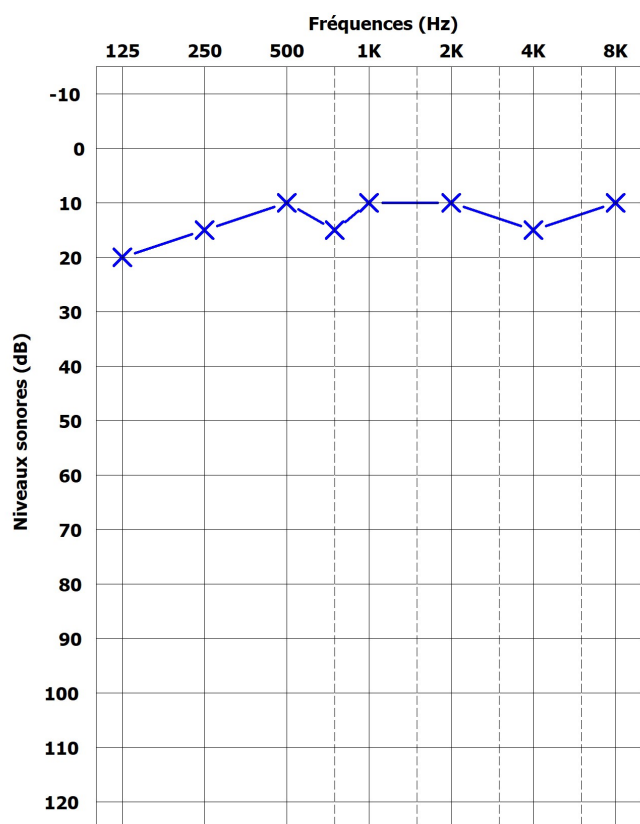

Oreille Gauche

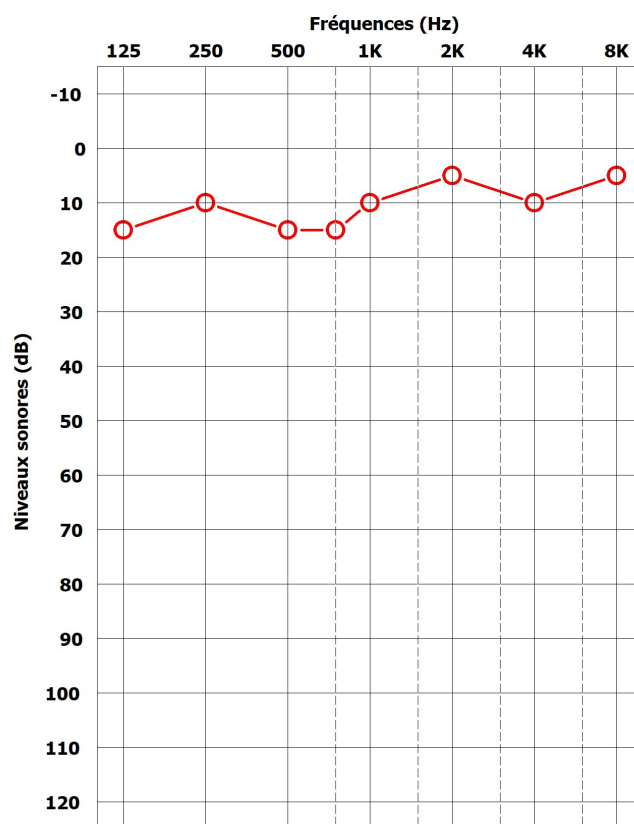

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	15	10		10		15		10
CA Droit	15	10	15	15	10		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes