

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 13:01:58

Durée: 8mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MANSARE LAYE FODE	
Date de naissance	23/08/1981
Age	43
Société	CR18
ID	24122113000309334

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

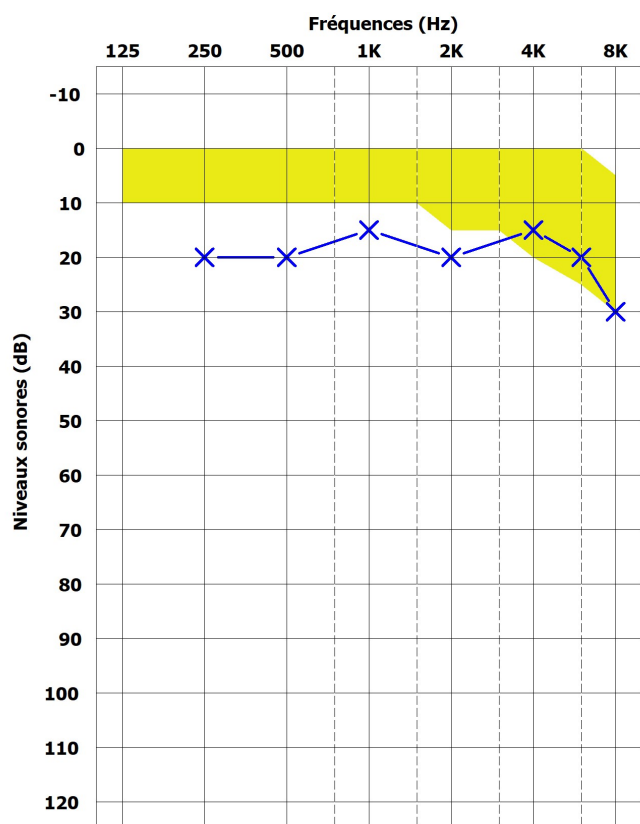

Oreille Gauche

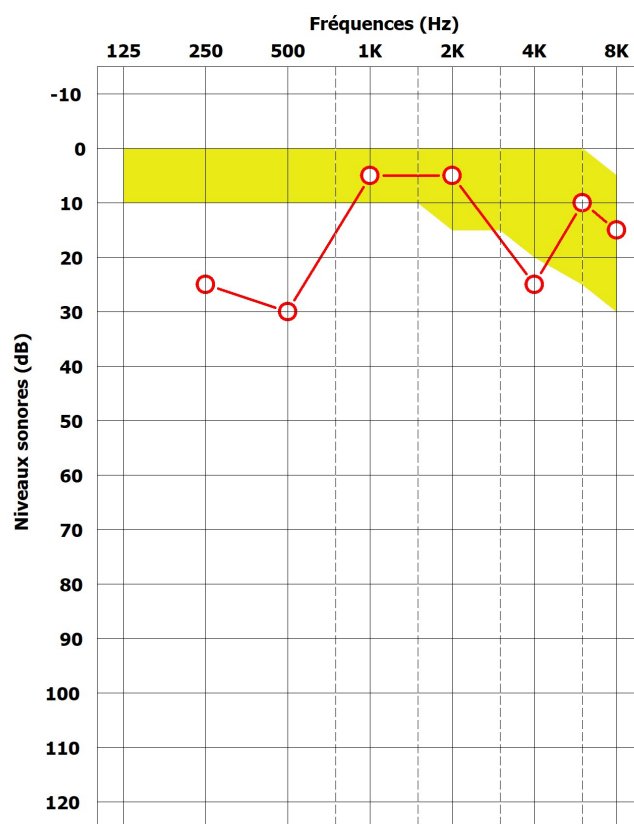

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		15		20		15	20	30
CA Droit		25	30		5		5		25	10	15

Calcul de perte	
	PAM
CA Gauche	15,0 dB
CA Droit	5,0 dB

Notes