


MEDVIE


Date du test: 30/06/2025 19:27:02
Durée: 3mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		LIFENG ZHAO
Date de naissance	27/02/1979	
Age	46	
Société	CR18	
ID	25063019224804812	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

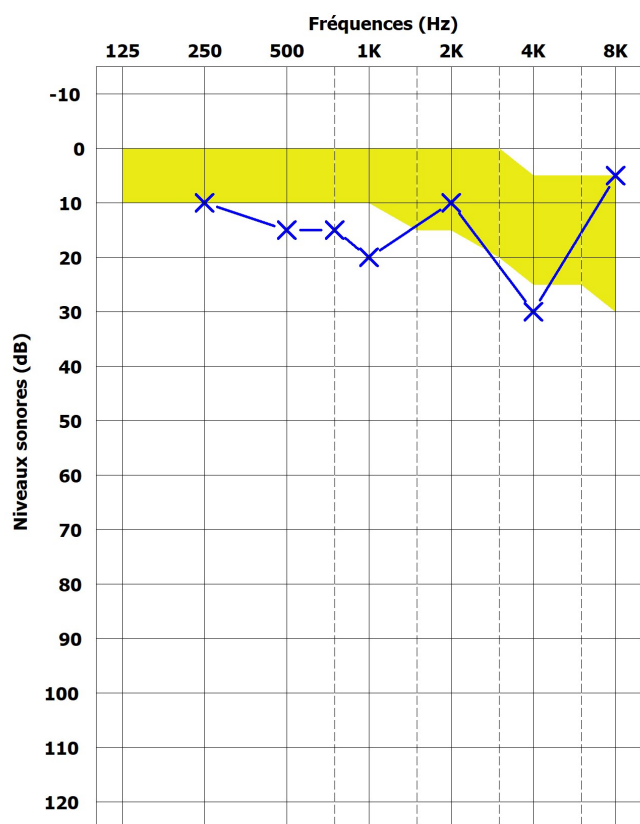

Oreille Gauche

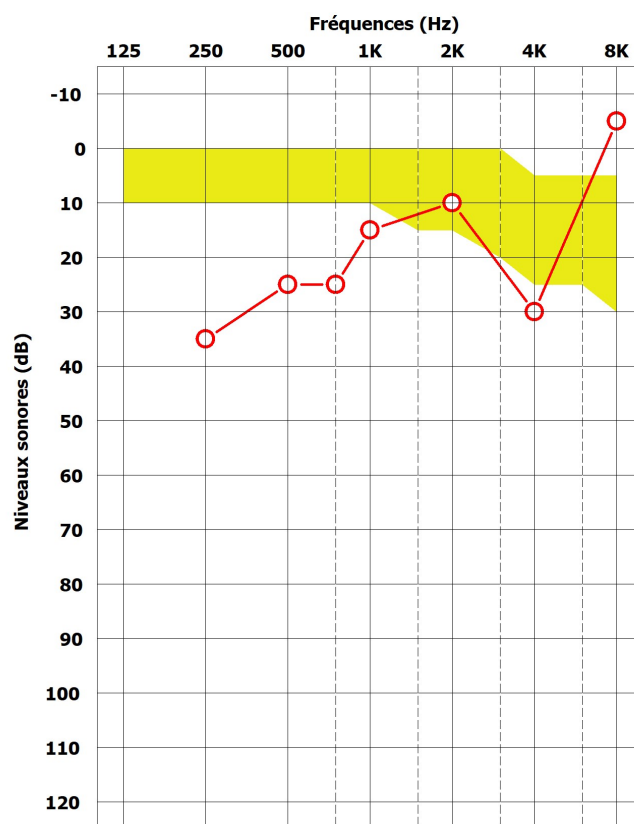

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	20		10		30		5
CA Droit		35	25	25	15		10		30		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes