


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 15:15:15  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Manuel  
 Continu

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KEÏTA MAMADY      |                   |
| Date de naissance | 02/04/2001        |
| Age               | 23                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24053115112047294 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

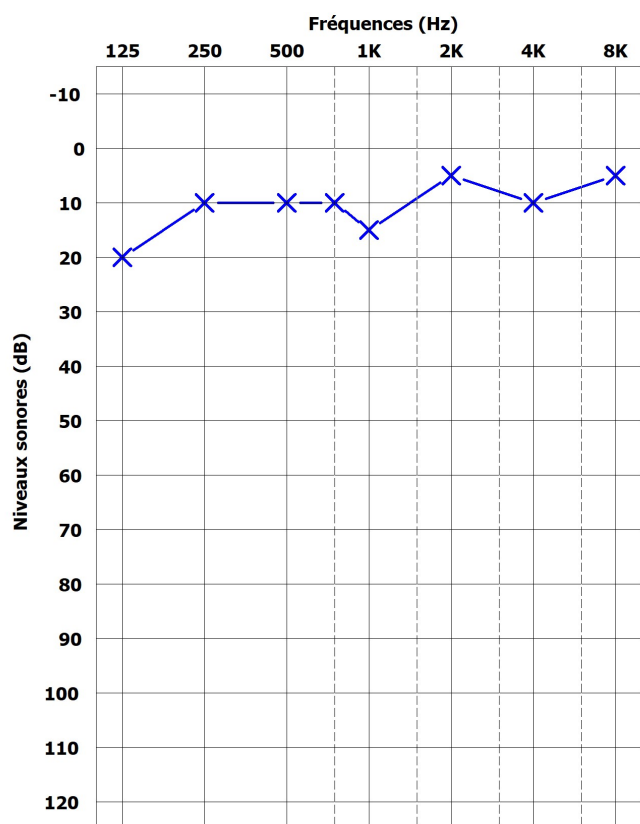

Oreille Gauche

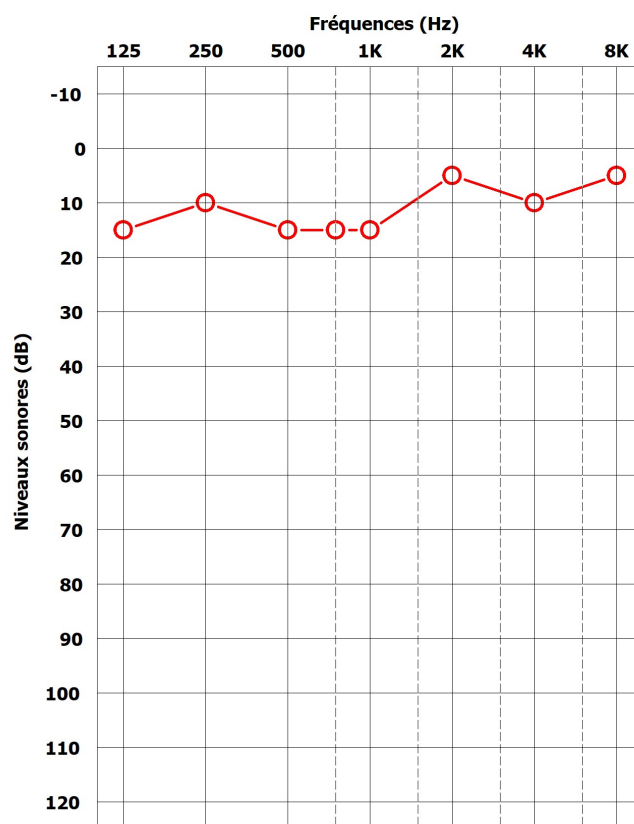

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 10  | 10  | 10  | 15 |     | 5  |    | 10 |    | 5  |
| CA Droit  | 15  | 10  | 15  | 15  | 15 |     | 5  |    | 10 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes