


MEDVIE


Date du test: 30/06/2025 19:55:23
Durée: 5mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
NIANJIANG ZHOU	
Date de naissance	01/12/1974
Age	50
Société	CR18
ID	25063019522919724

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

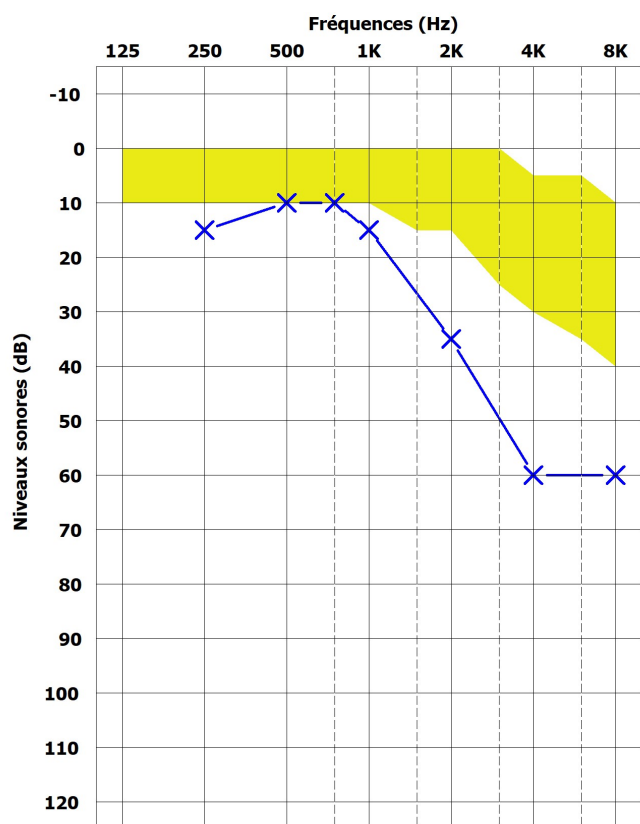

Oreille Gauche

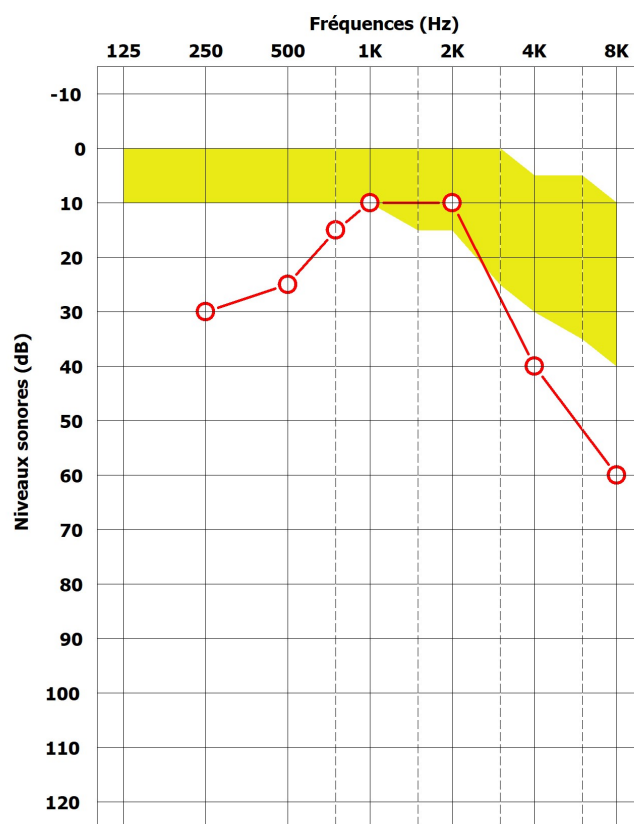

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	15		35		60		60
CA Droit		30	25	15	10		10		40		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes