

MEDVIE


Date du test: 16/07/2025 18:35:03

Durée: 5mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAOGUI ZENG	
Date de naissance	19/05/1979
Age	46
Société	CR18
ID	25071618331908638

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

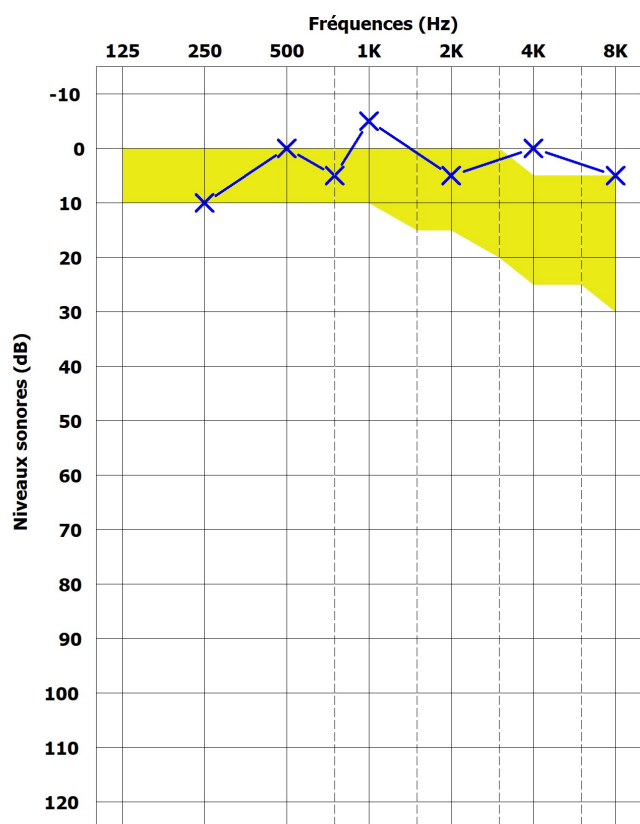

Oreille Gauche

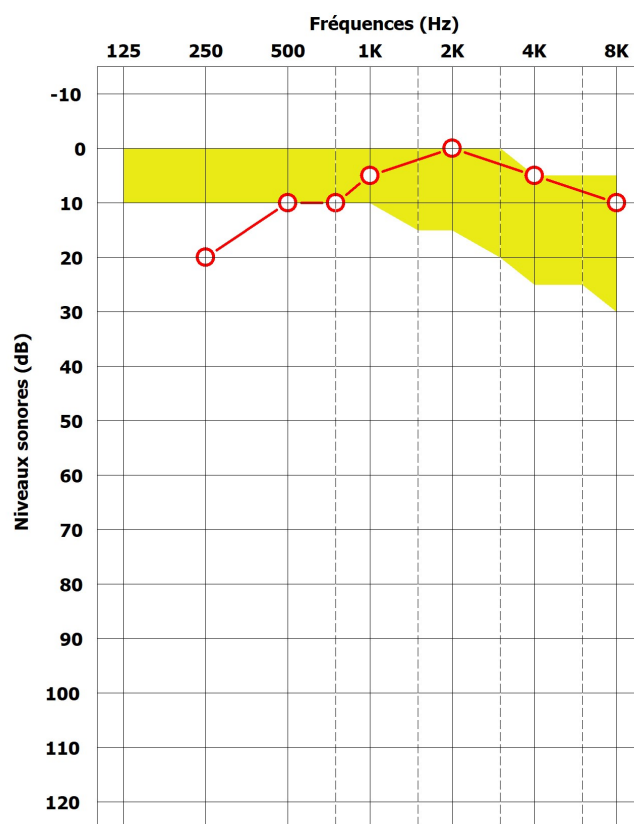

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	0	5	-5		5		0		5
CA Droit		20	10	10	5		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes