

MEDVIE BEYLA


Date du test: 02/01/2025 13:09:34

Durée: 5mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		FOFA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1998	
Age	27	
Société	CR18	
ID	25010213024896155	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

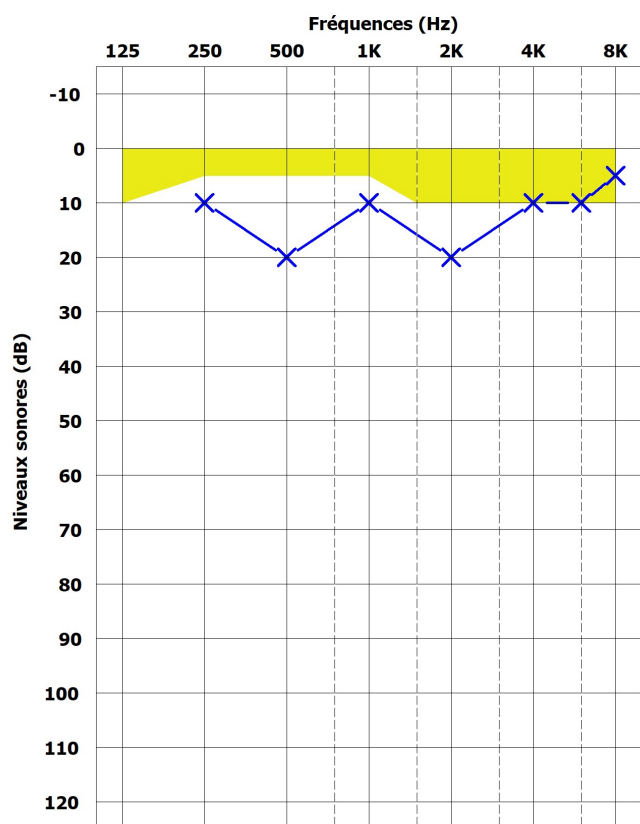

Oreille Gauche

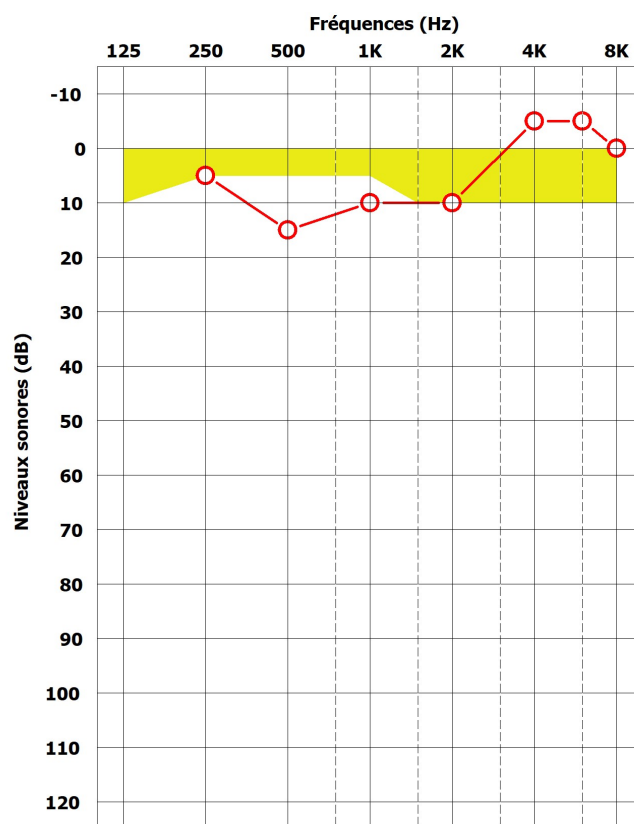

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		10		20		10	10	5
CA Droit		5	15		10		10		-5	-5	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes