


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 14:51:11
Durée: 0mn 45s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	TRAORE KOMI
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24050718194633096

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

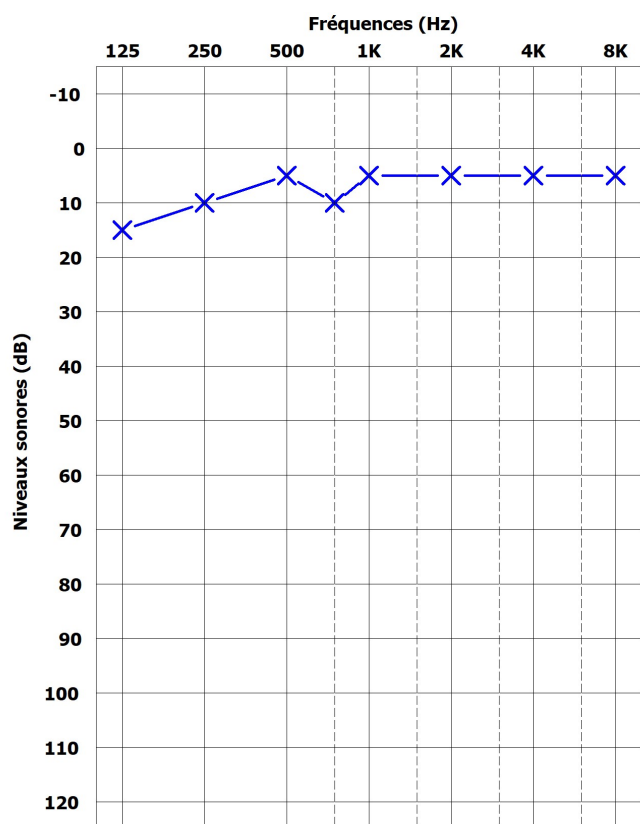

Oreille Gauche

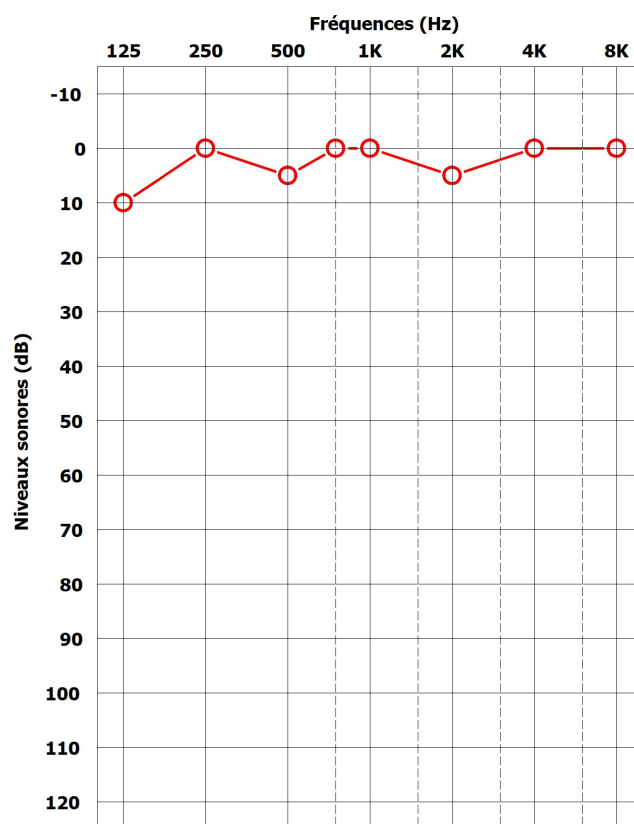

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	5	10	5		5		5		5
CA Droit	10	0	5	0	0		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes