


MEDVIE


Date du test: 14/05/2024 14:39:45
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		TRAORE SIDIKI
Date de naissance		01/01/2004
Age		20
Société		CR18
ID		24051414355811773

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

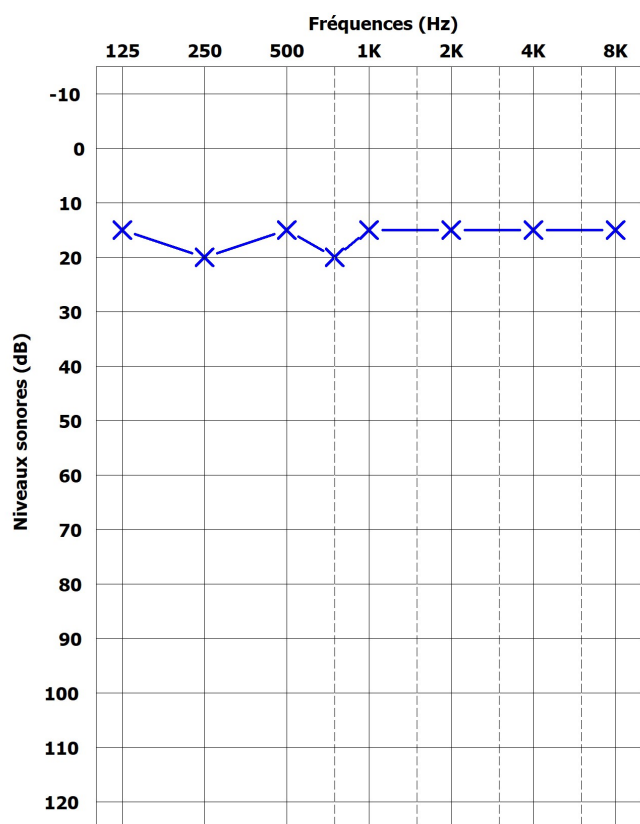

Oreille Gauche

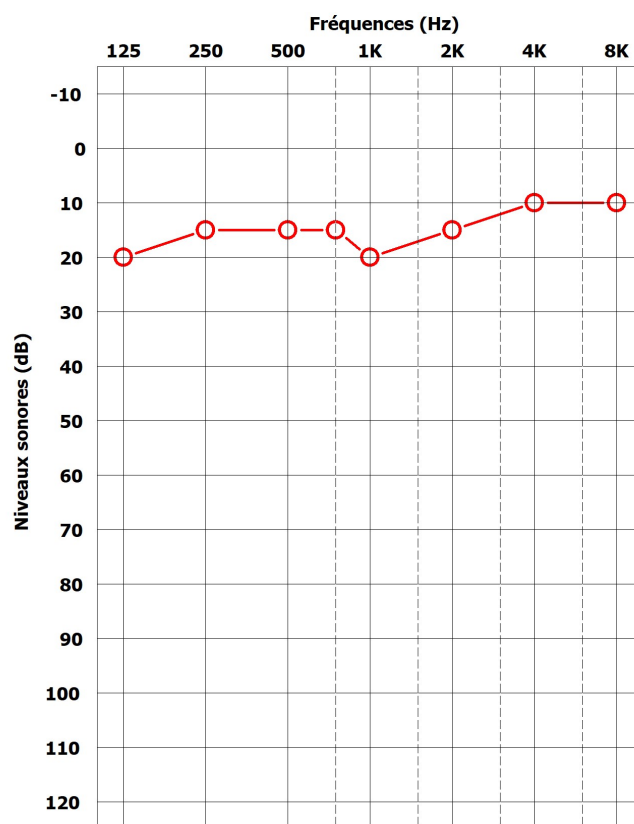

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	20	15		15		15		15
CA Droit	20	15	15	15	20		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes