


MEDVIE

Date du test: 10/03/2025 12:49:11

Durée: 4mn 23s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

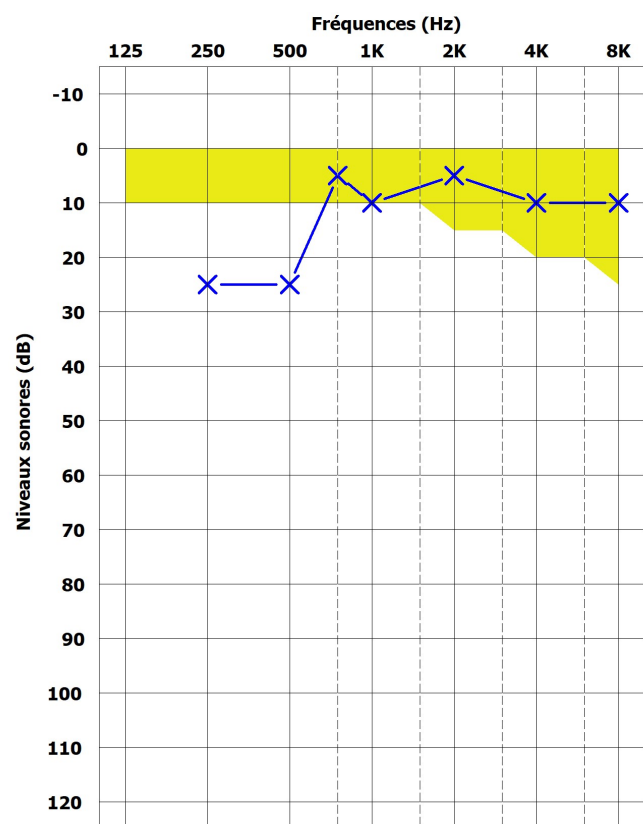

Oreille Gauche

| Données Patient   |                   | DIALLO MAMADOU<br>HARIR |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Date de naissance | 01/04/1982        |                         |
| Age               | 42                |                         |
| Société           | CR18              |                         |
| ID                | 25031012480549592 |                         |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

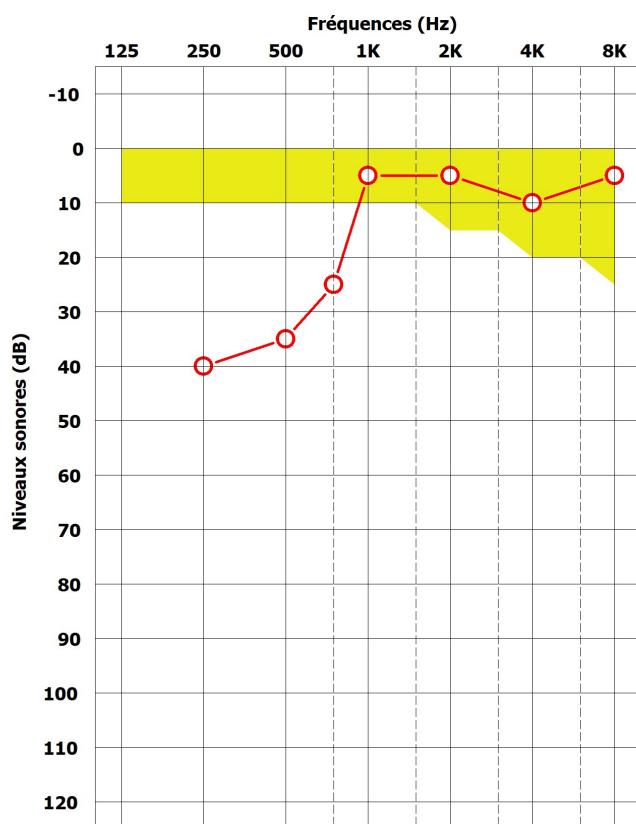

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 5   | 10 |     | 5  |    | 10 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 40  | 35  | 25  | 5  |     | 5  |    | 10 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes