


MEDVIE

Date du test: 01/10/2024 15:56:42

Durée: 4mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

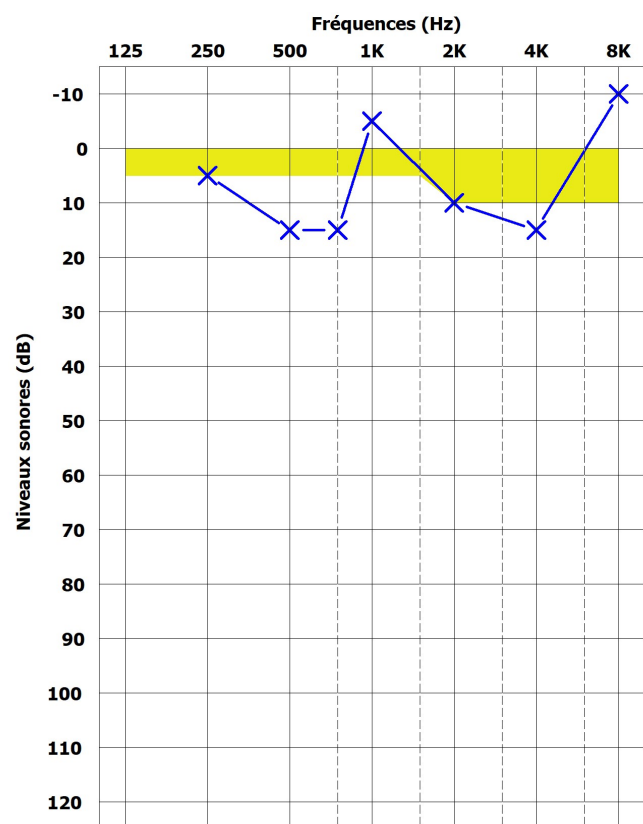

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUMBOUYA CHEICK AHMED	
Date de naissance	02/11/2000
Age	23
Société	CR18
ID	24100115530191971

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

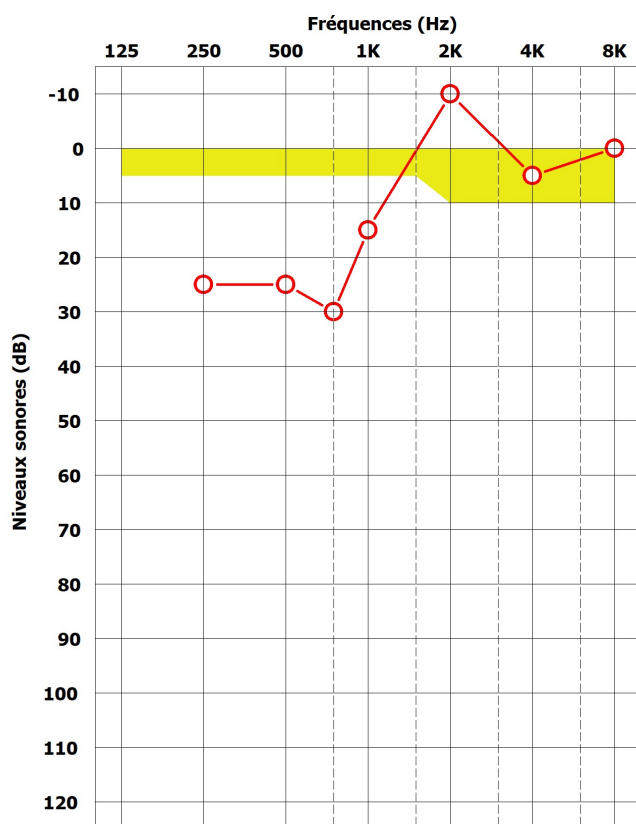

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	-5		10		15		-10
CA Droit		25	25	30	15		-10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes