


MEDVIE

Date du test: 01/10/2024 12:16:46

Durée: 5mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

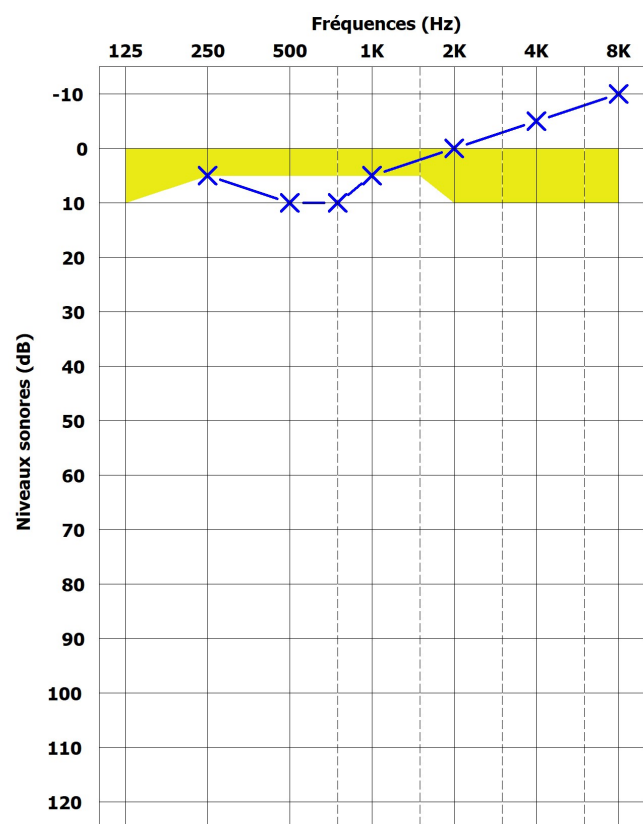

Oreille Gauche

Données Patient		BARKY I NIEMO ROIRACAR
Date de naissance	15/06/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24100112130044840	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

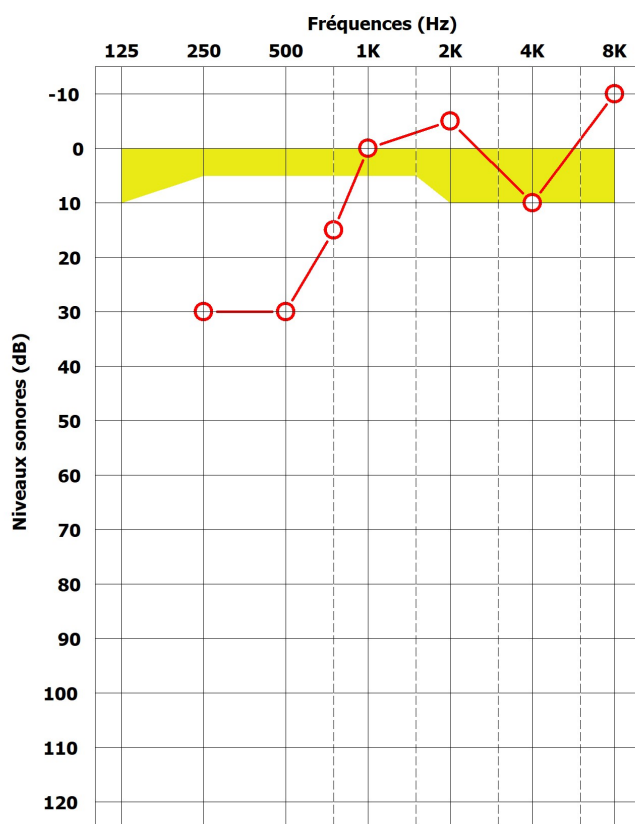

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		0		-5		-10
CA Droit		30	30	15	0		-5		10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes