

MEDVIE BEYLA

Date du test: 12/12/2024 15:28:55

Durée: 6mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CHERIF OUSMANE

Date de naissance 01/01/1997

Age 27

Société CR18


ID 24121215270107283

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

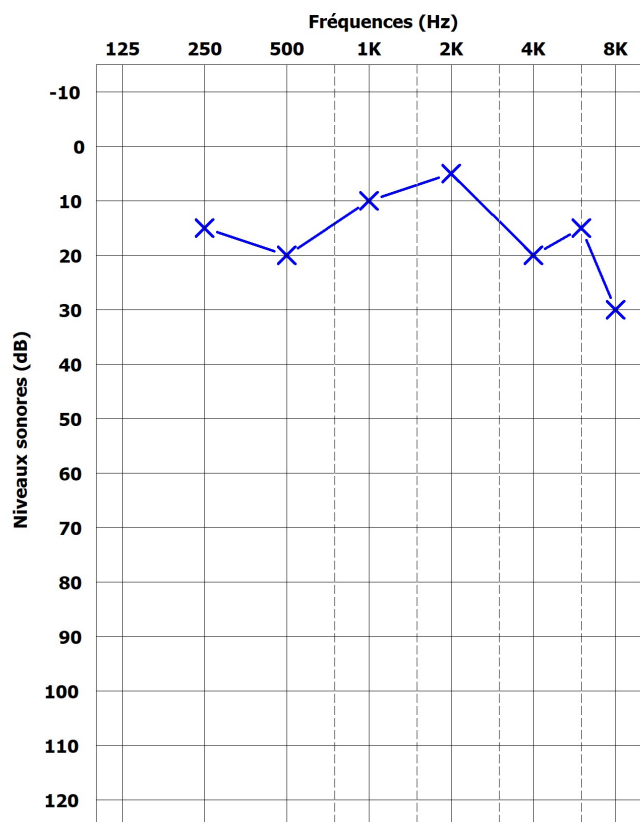

Oreille Gauche

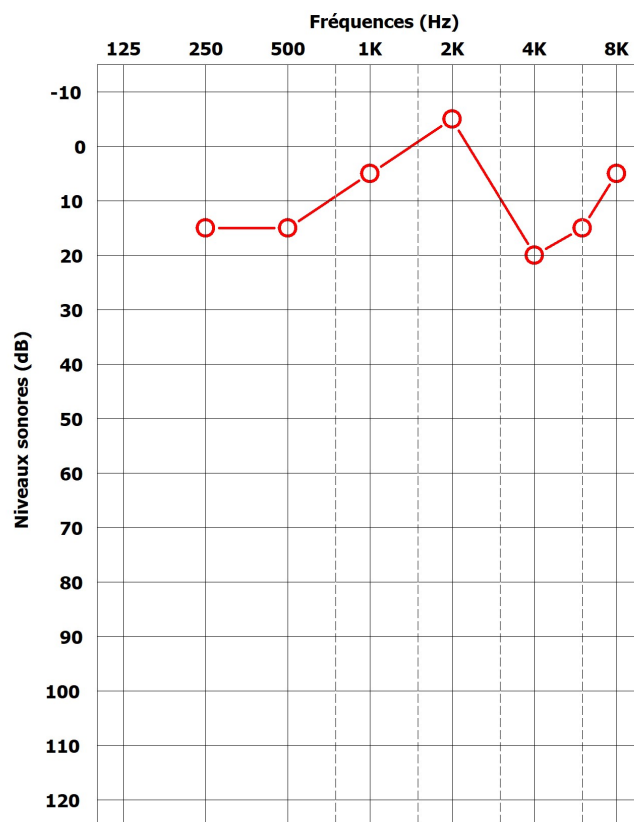

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20		10		5		20	15	30
CA Droit		15	15		5		-5		20	15	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes