

MEDVIE

Date du test: 15/05/2024 10:59:58

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

SIDIBE KEMO

Date de naissance 01/01/1991

Age 33

Société CR18


ID 24051510562802381

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

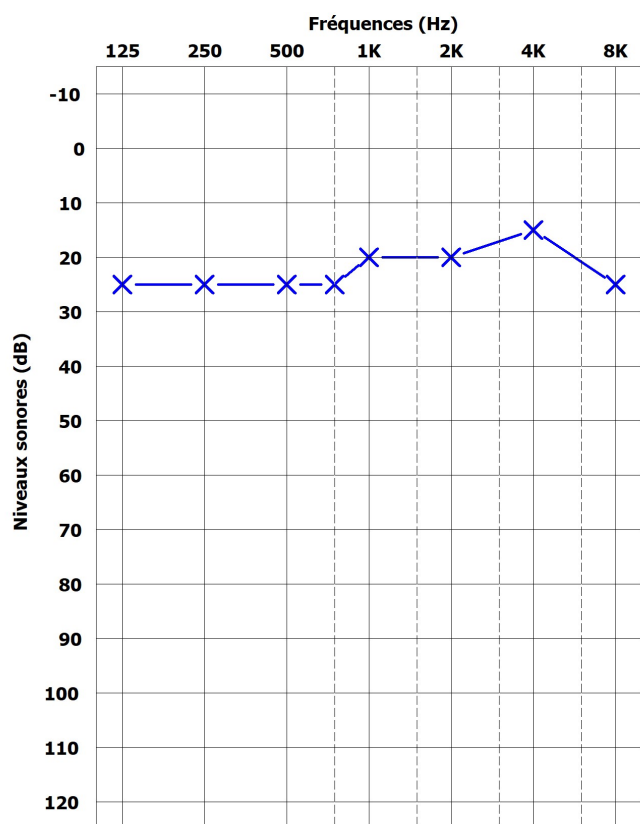

Oreille Gauche

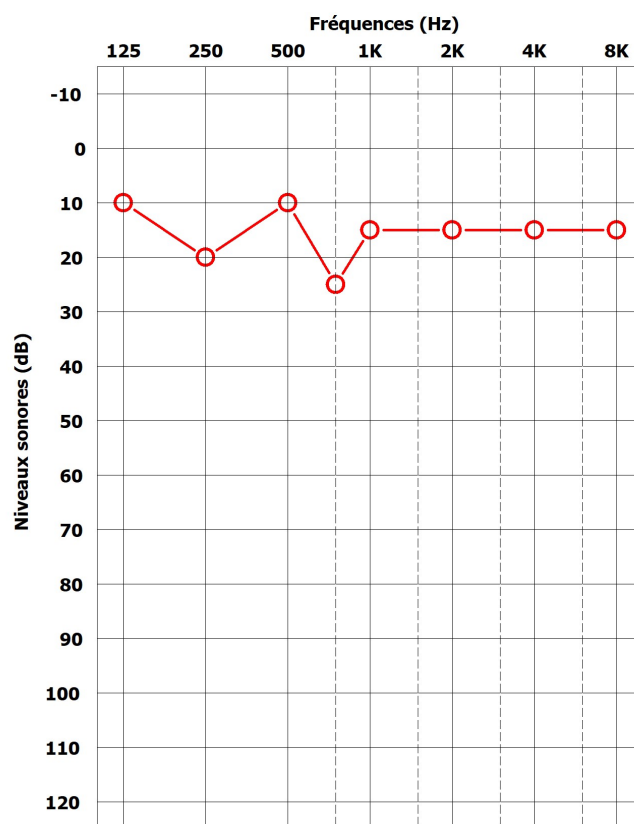

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	25	20		20		15		25
CA Droit	10	20	10	25	15		15		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes