


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:08:21

Durée: 3mn 46s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

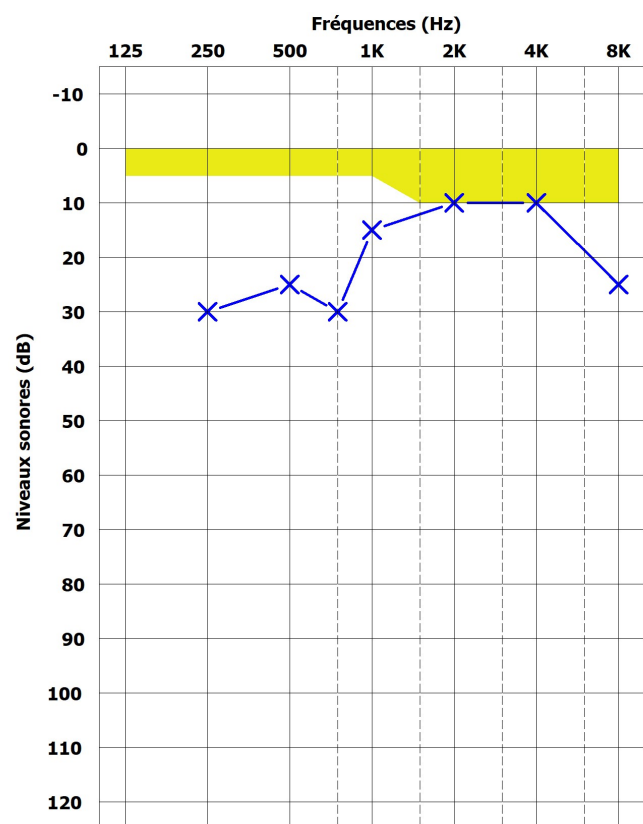

Oreille Gauche

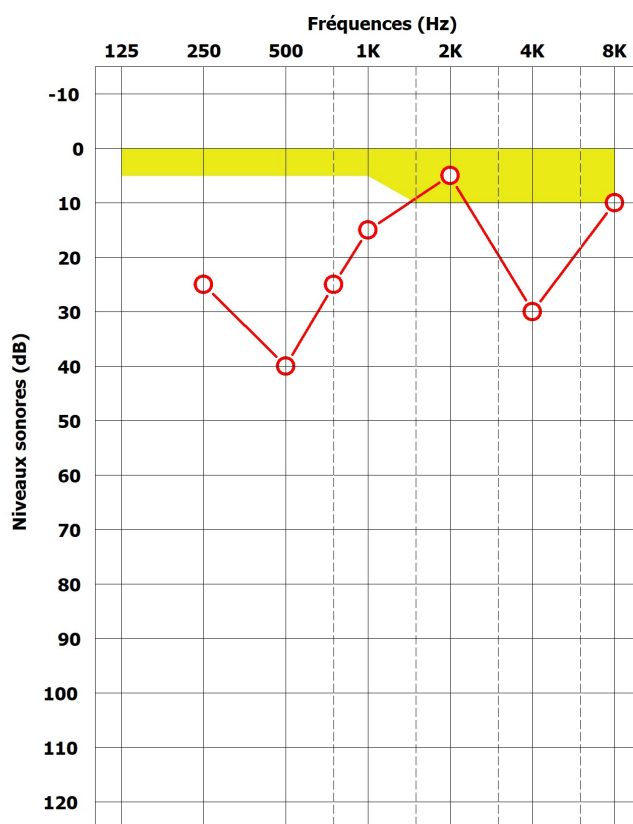

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	30	15		10		10		25
CA Droit		25	40	25	15		5		30		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA AICHA
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25031313025675468

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021