


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 11:08:50
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		KANTE MORY
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	CR18	
ID	24051511053786457	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

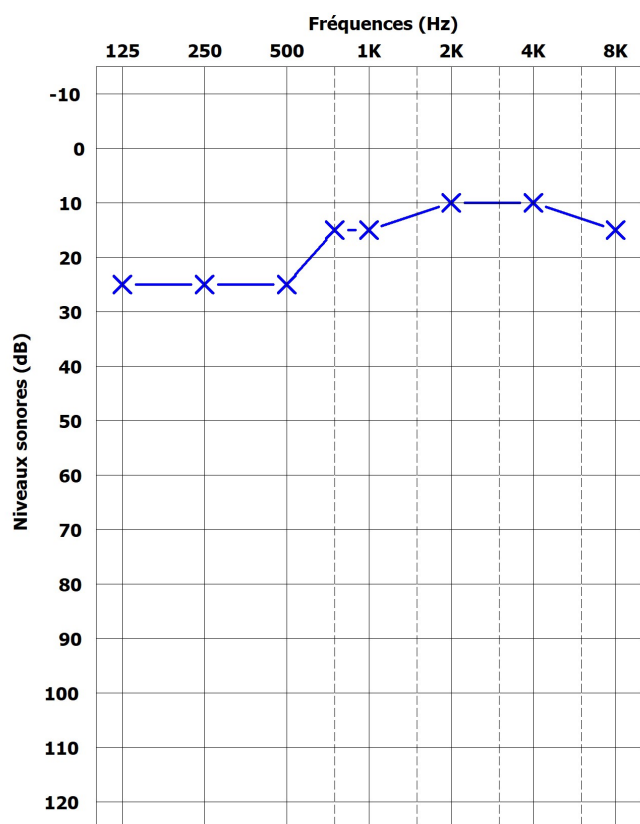

Oreille Gauche

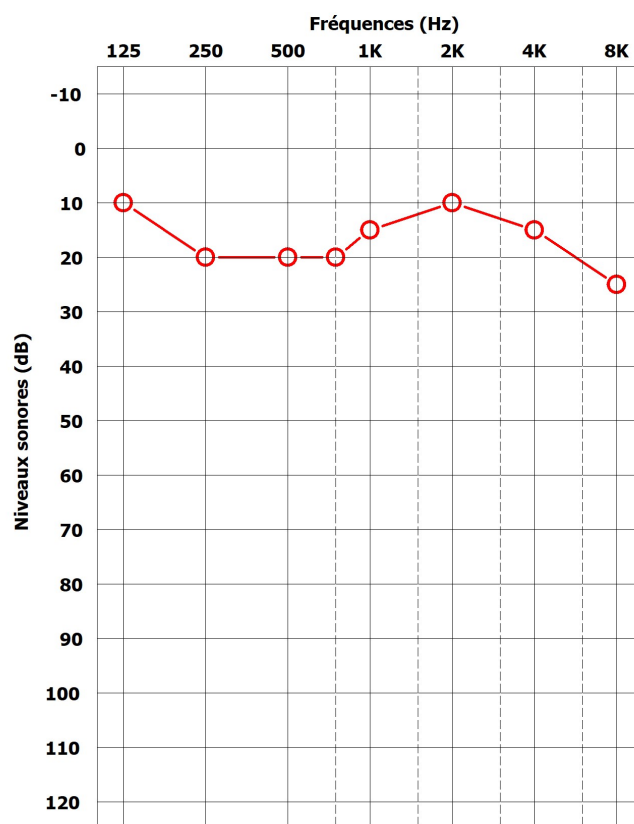

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	15	15		10		10		15
CA Droit	10	20	20	20	15		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes