


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 13:00:55  
Durée: 4mn 04s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CHEN YADONG       |                   |
| Date de naissance | 20/01/1976        |
| Age               | 49                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25031812585364662 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

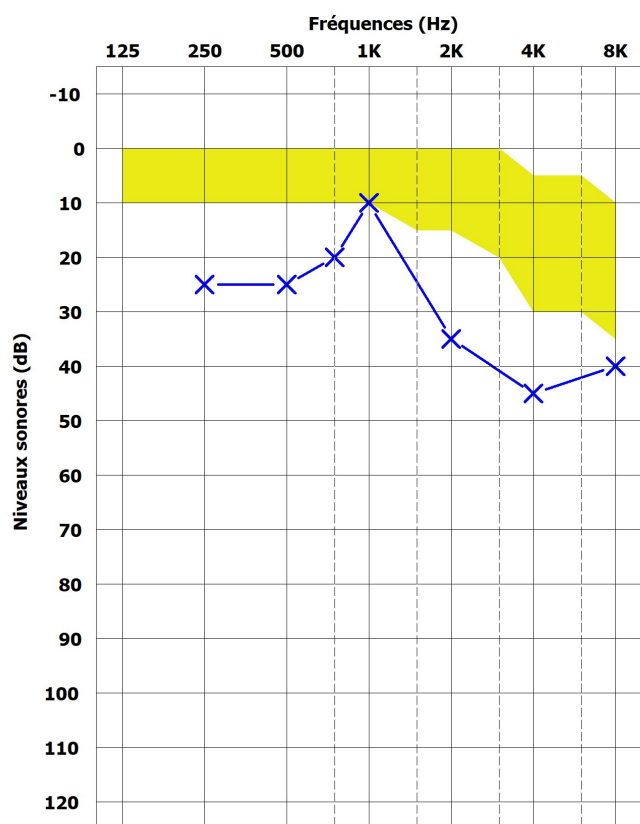

Oreille Gauche

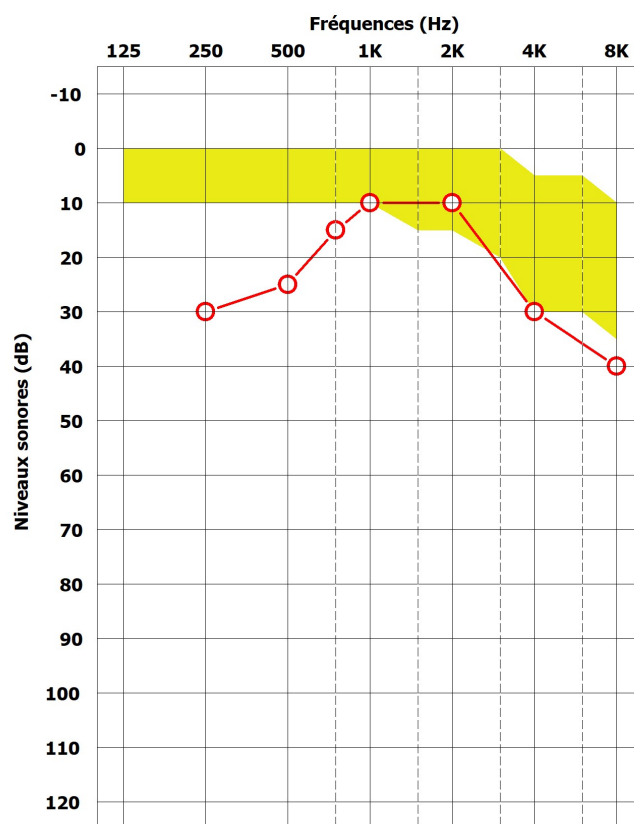

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 20  | 10 |     | 35 |    | 45 |    | 40 |
| CA Droit  |     | 30  | 25  | 15  | 10 |     | 10 |    | 30 |    | 40 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 28,8 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes