



Données Patient		DANG BO
Date de naissance	07/01/1992	
Age	32	
Société	CR18	
ID	24050710013794176	

Date du test: 07/05/2024 10:02:56
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

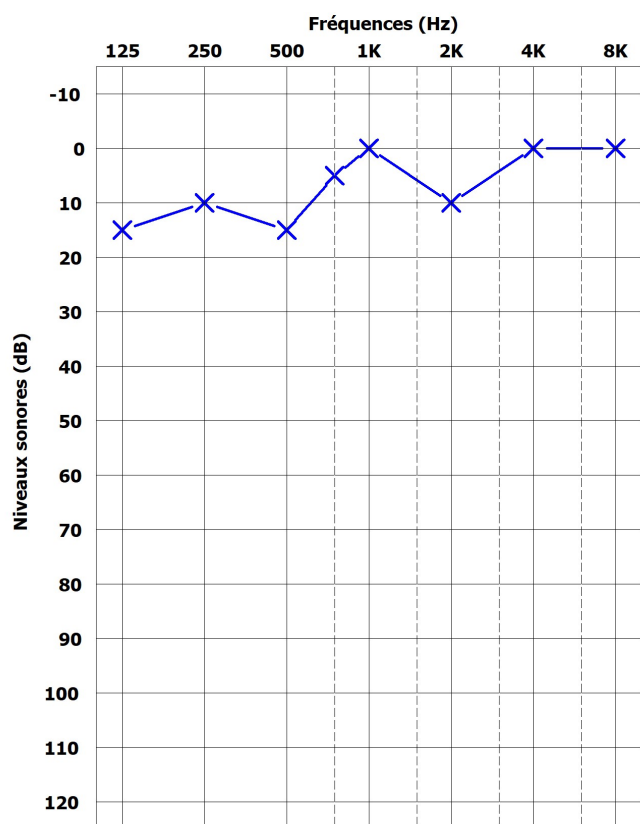

Oreille Gauche

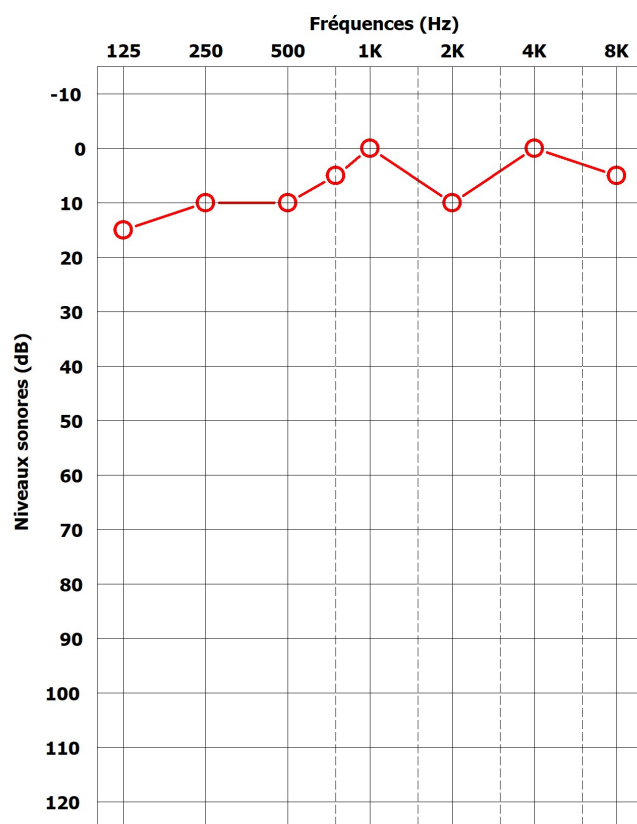

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	5	0		10		0		0
CA Droit	15	10	10	5	0		10		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes