



Données Patient		LI SEN
Date de naissance	03/02/1976	
Age	48	
Société	CR18	
ID	24050710440507542	

Date du test: 07/05/2024 10:45:56
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

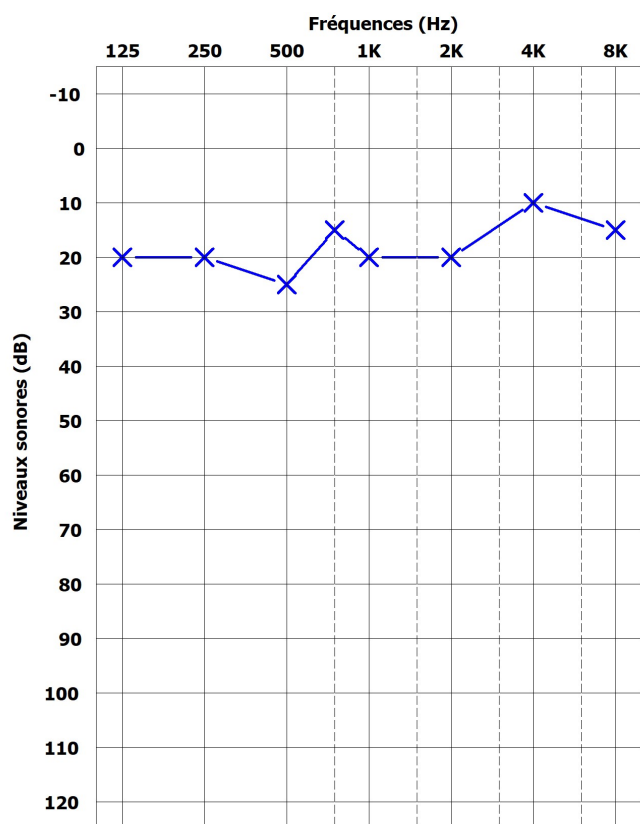

Oreille Gauche

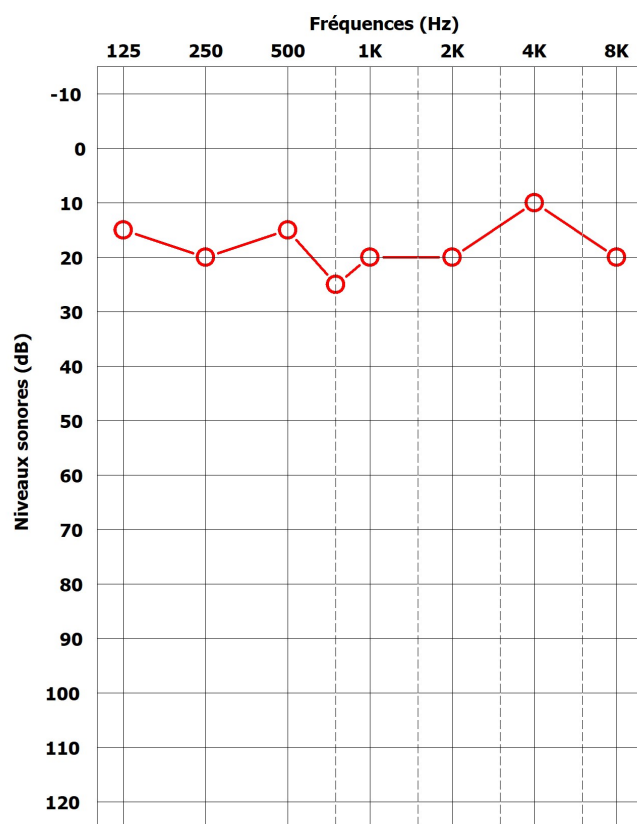

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	25	15	20		20		10		15
CA Droit	15	20	15	25	20		20		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes