

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:55:03

Durée: 4mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SIDIBE ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25031311380050638

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

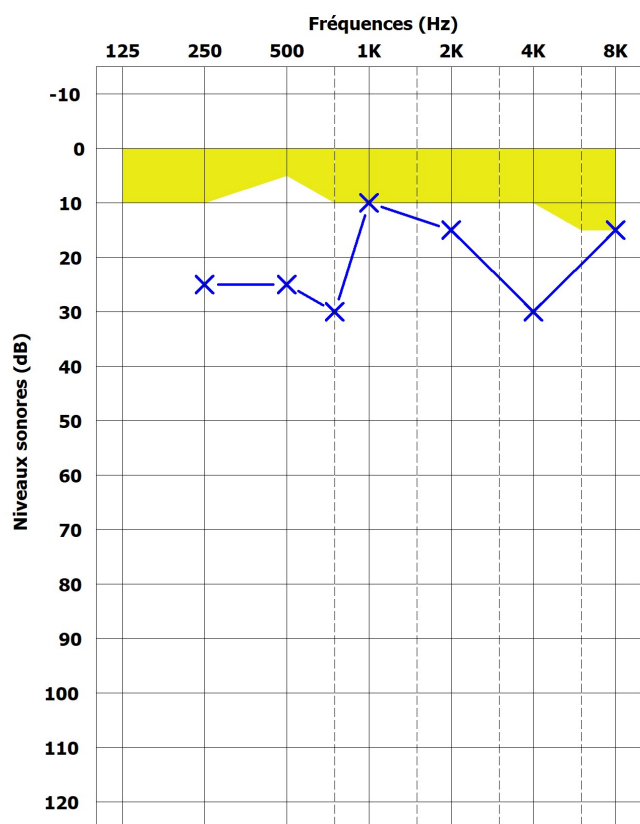

Oreille Gauche

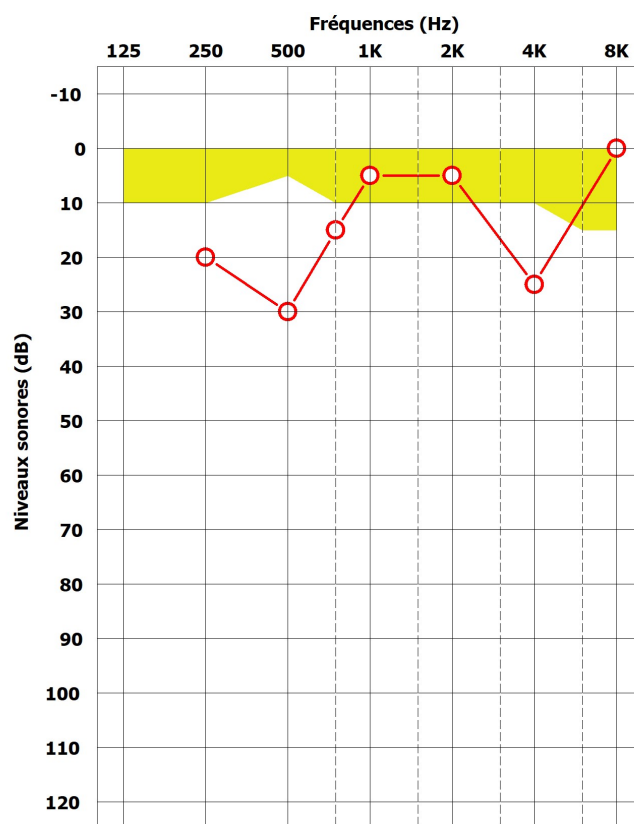

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	30	10		15		30		15
CA Droit		20	30	15	5		5		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes