

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 10:56:05

Durée: 4mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA MOHAMED	
Date de naissance	03/05/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25031410544892144

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

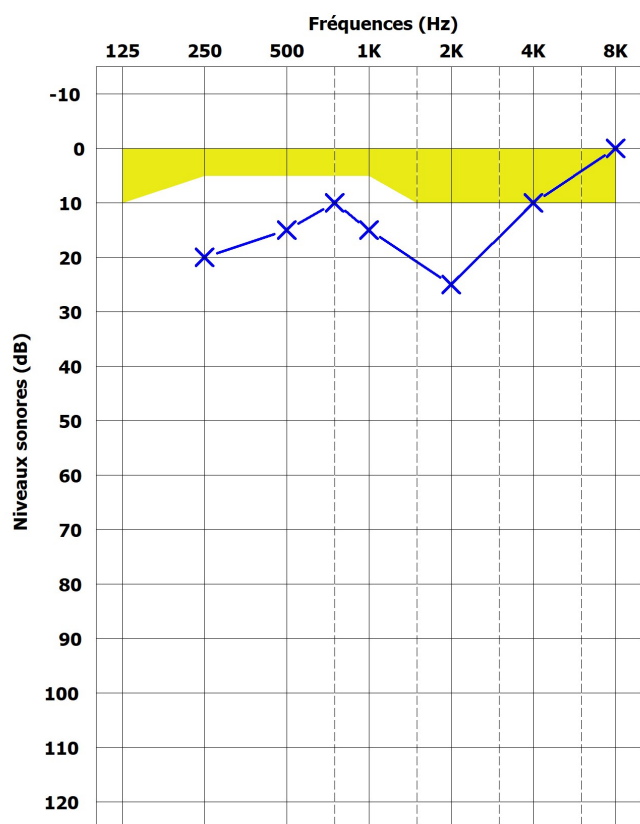

Oreille Gauche

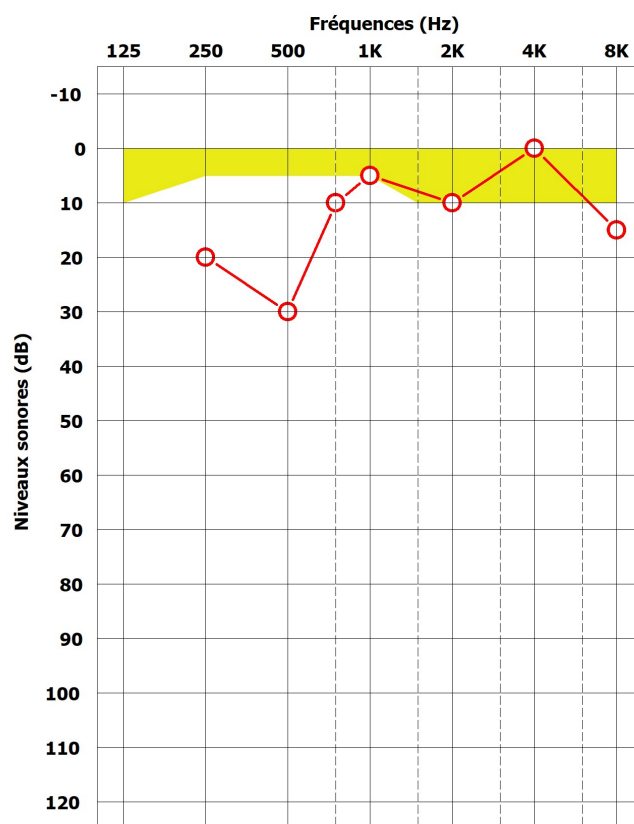

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	10	15		25		10		0
CA Droit		20	30	10	5		10		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes