



Données Patient	CHEN YAQIANG
Date de naissance	26/08/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25062315551574489

Date du test: 23/06/2025 15:57:11
 Durée: 5mn 58s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

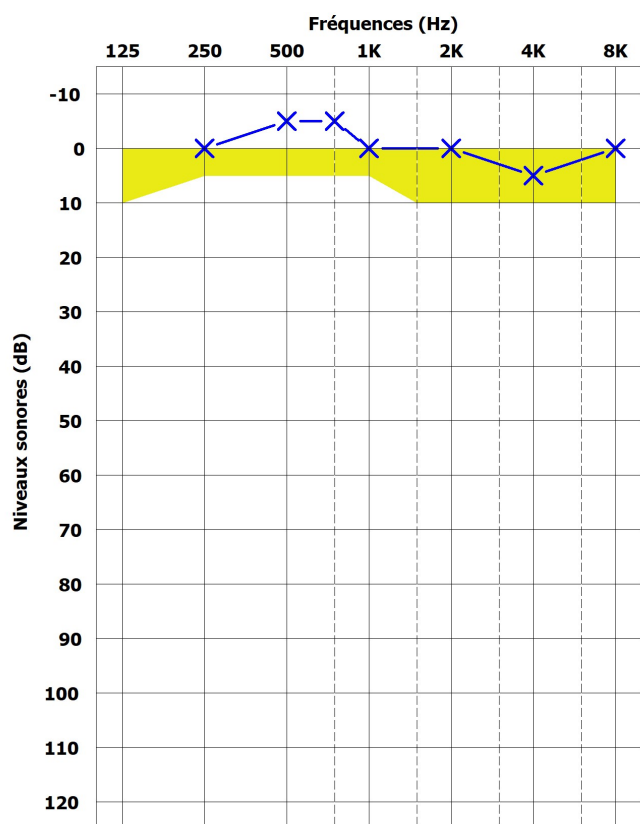

Oreille Gauche

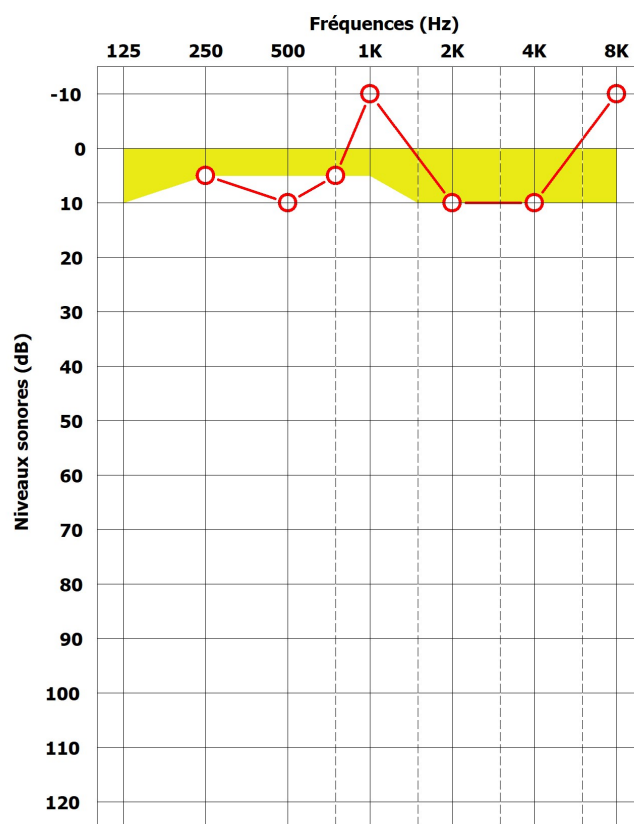

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-5	-5	0		0		5		0
CA Droit		5	10	5	-10		10		10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes