

Données Patient

KONATE MOUSSA

Date de naissance 01/01/1986
Age 39
Société CR18
ID 25031111123537663


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 11/03/2025 11:19:47

Durée: 4mn 27s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

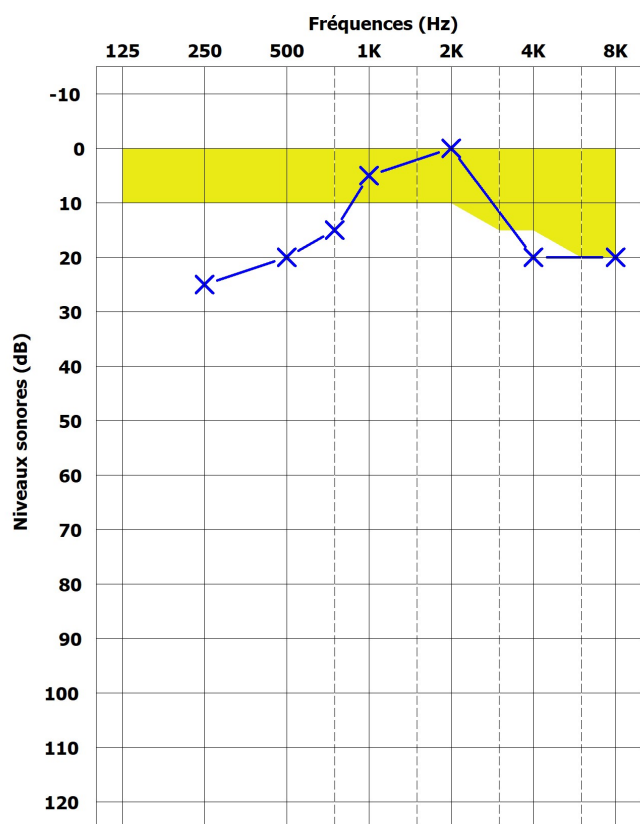

Oreille Gauche

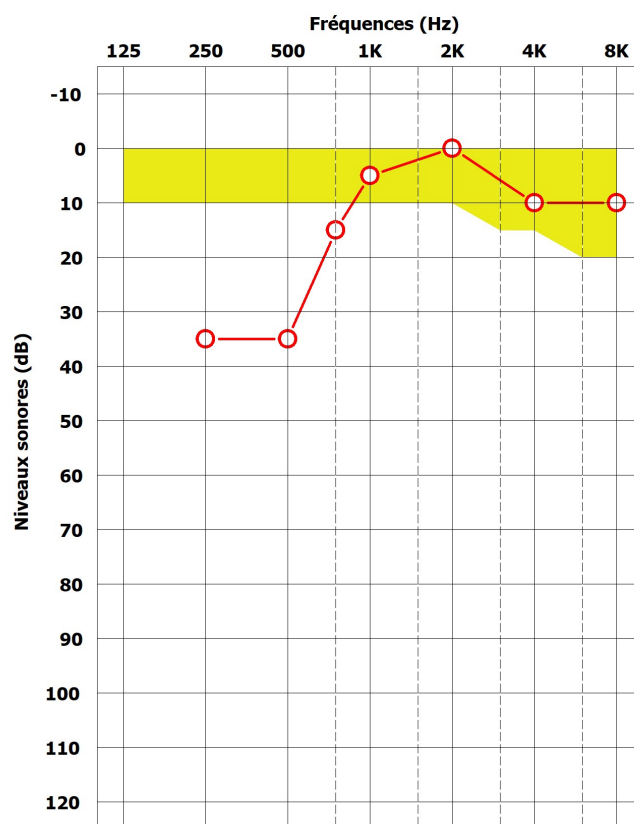

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	5		0		20		20
CA Droit		35	35	15	5		0		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes