

MEDVIE

Date du test: 05/08/2025 17:26:07

Durée: 3mn 44s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KEYTA MORY

Date de naissance 26/03/1997

Age 28

Société CR18


ID 25080517225637680

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

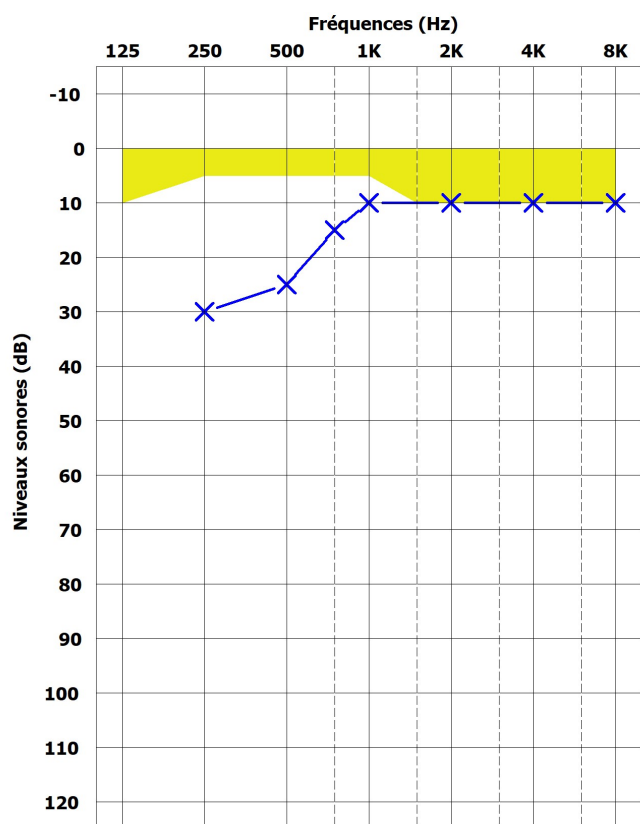

Oreille Gauche

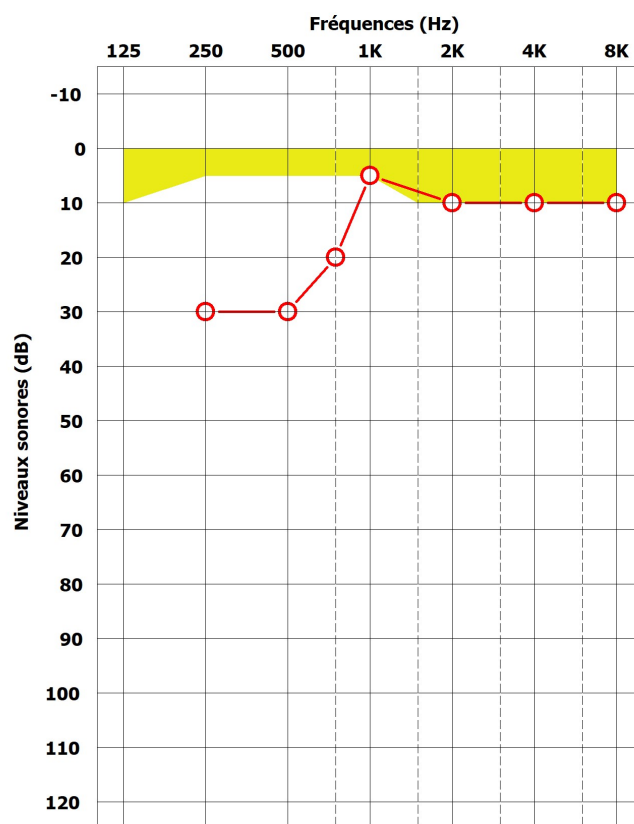

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		10		10		10
CA Droit		30	30	20	5		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes