


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 13:39:52
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CONDE DRISSA
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24051512025797987

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

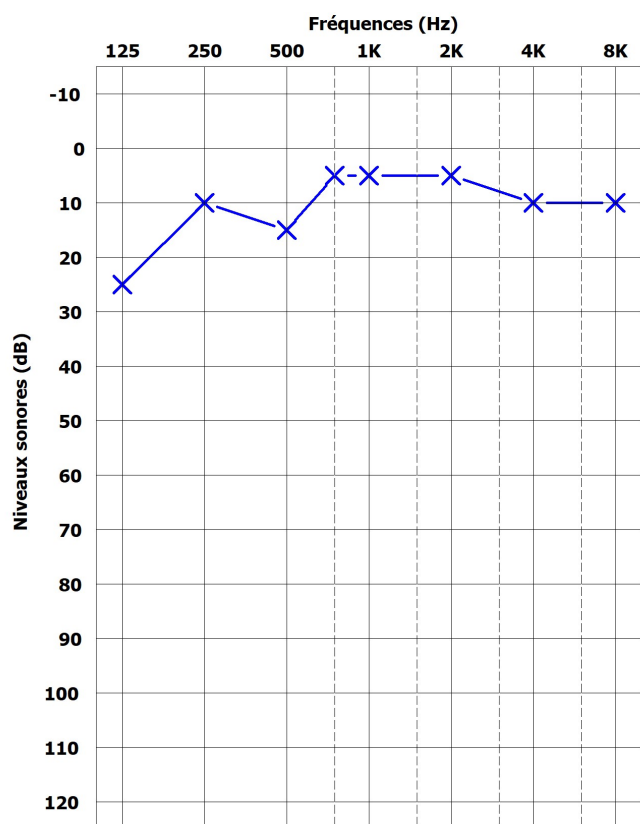

Oreille Gauche

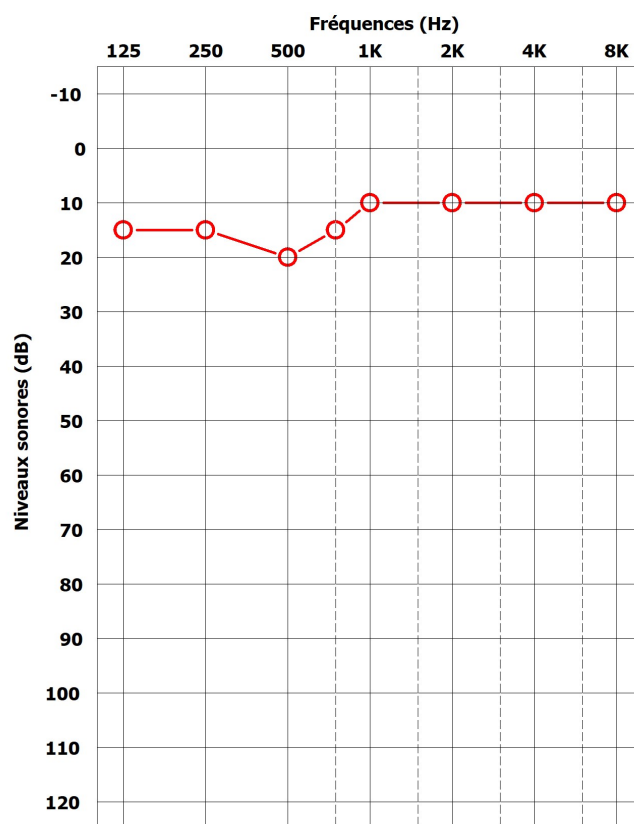

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	15	5	5		5		10		10
CA Droit	15	15	20	15	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes