


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 12:49:55
Durée: 3mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHANG YAOBIN	
Date de naissance	01/11/1974
Age	50
Société	CR18
ID	25072911241272636

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

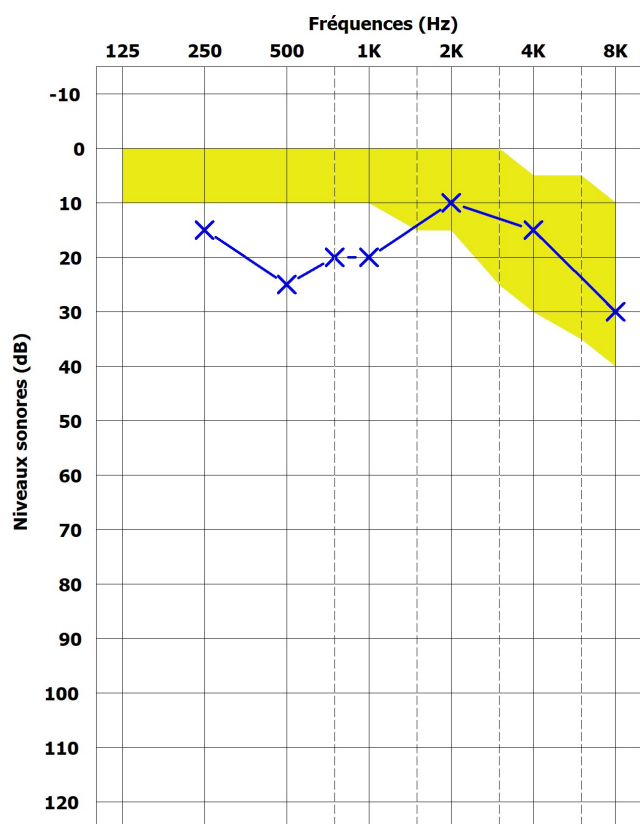

Oreille Gauche

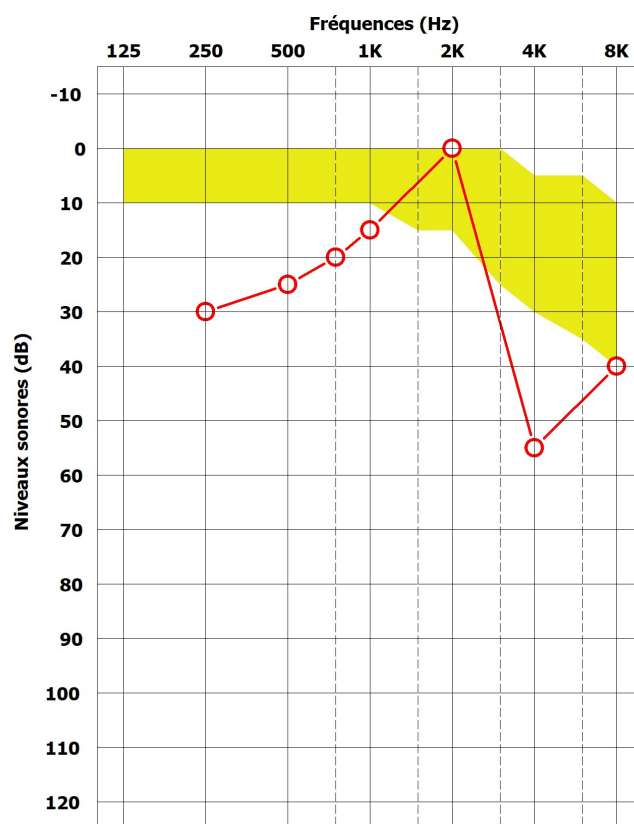

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	20		10		15		30
CA Droit		30	25	20	15		0		55		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes