



Données Patient		<b>DIABATE MORY</b>
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24051012033185890	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 10/05/2024 12:06:40  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Manuel  
 Continu

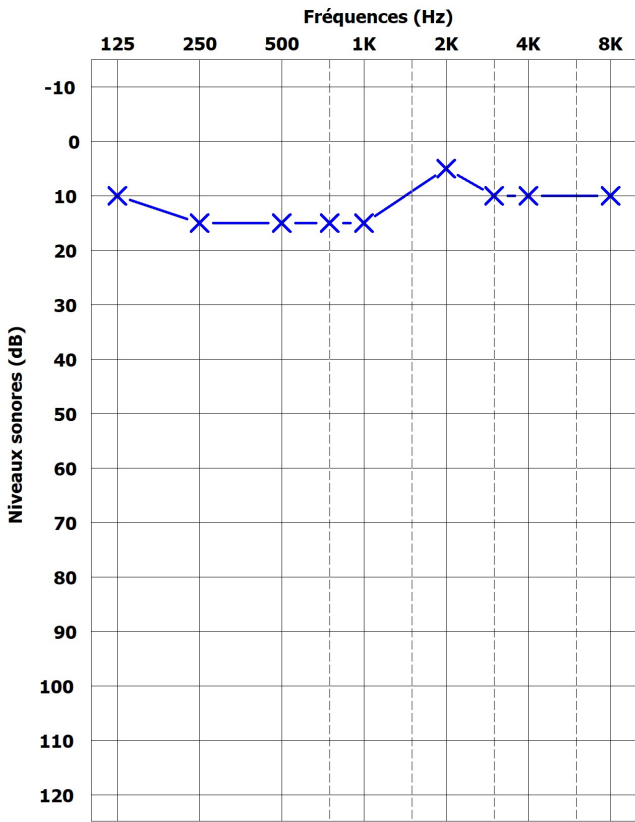

Oreille Gauche

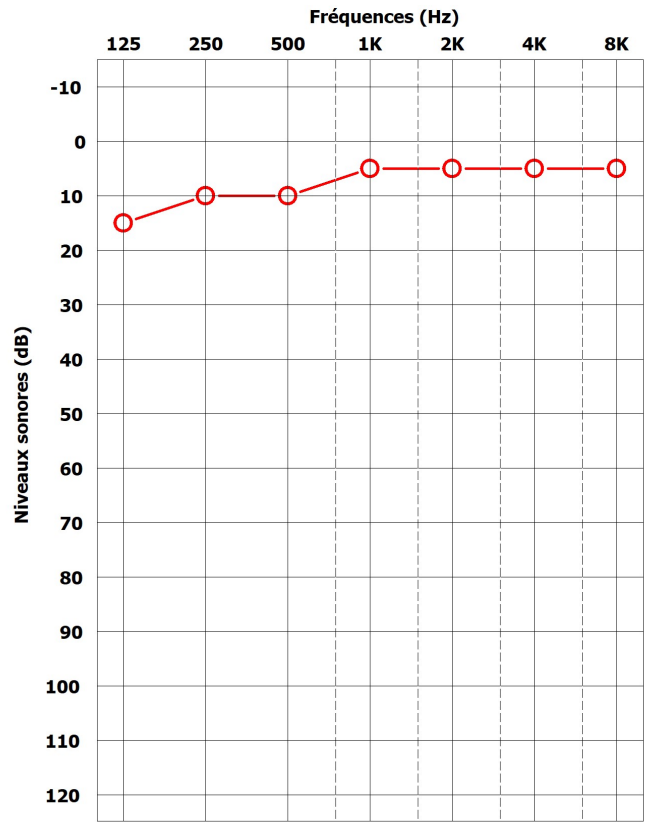

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	15	15	15		5	10	10		10
CA Droit	15	10	10		5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	11,3 dB
CA Droit	6,3 dB	---

Notes