



Données Patient


CAMARA MOHAMED

Date de naissance 24/04/1997
Age 27
Société CR18
ID 25030514531412350


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/03/2025 14:56:09
Durée: 5mn 11s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

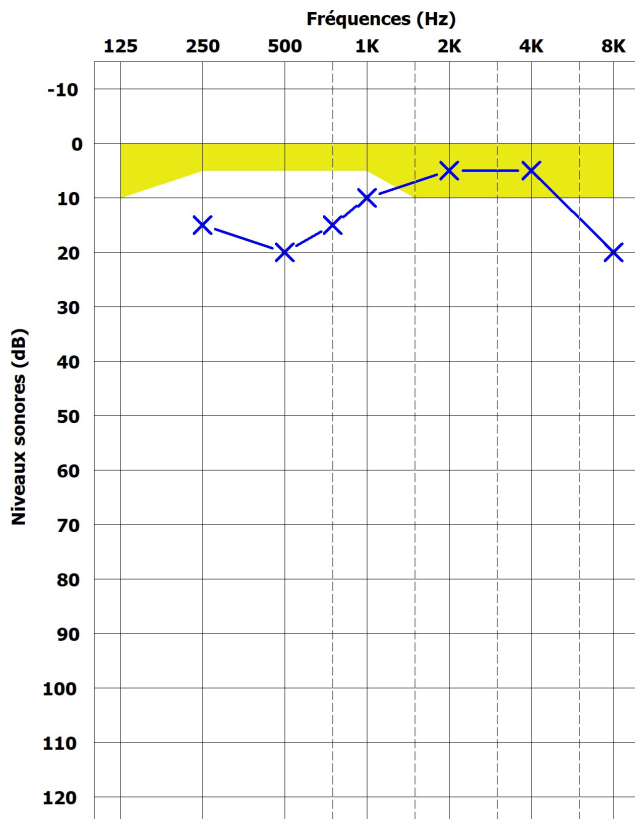

Oreille Gauche

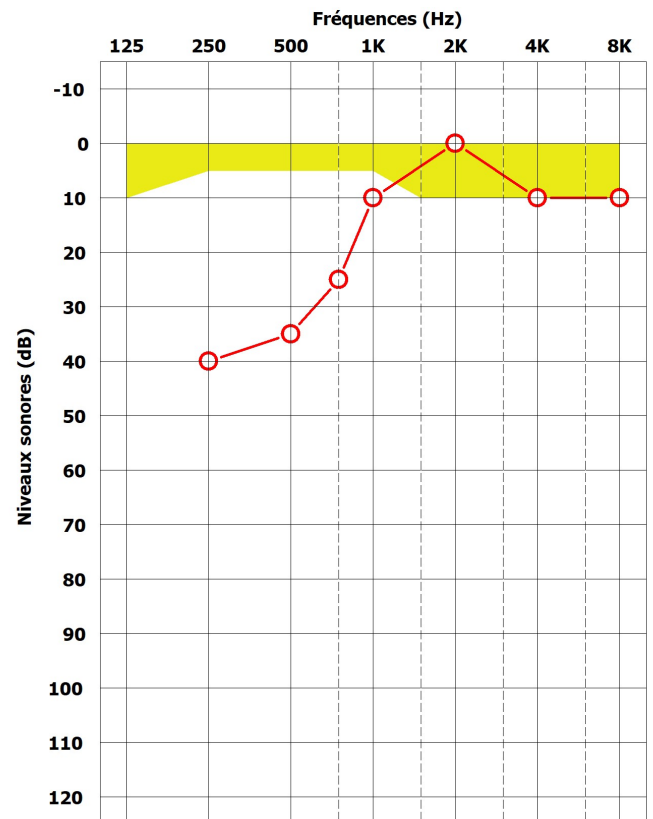

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		5		5		20
CA Droit		40	35	25	10		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes