


MEDVIE


Date du test: 17/05/2025 12:31:17
Durée: 6mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KANTE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25051712234765132

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

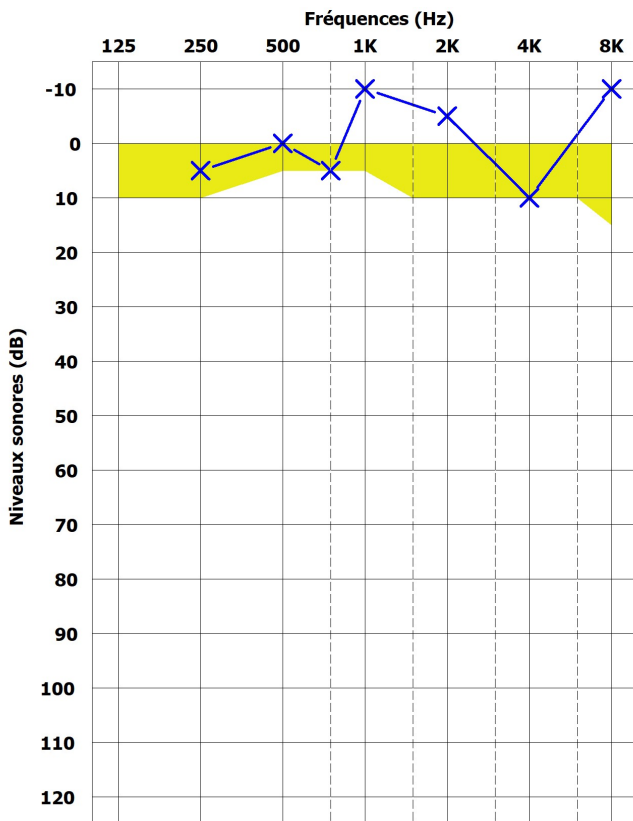

Oreille Gauche

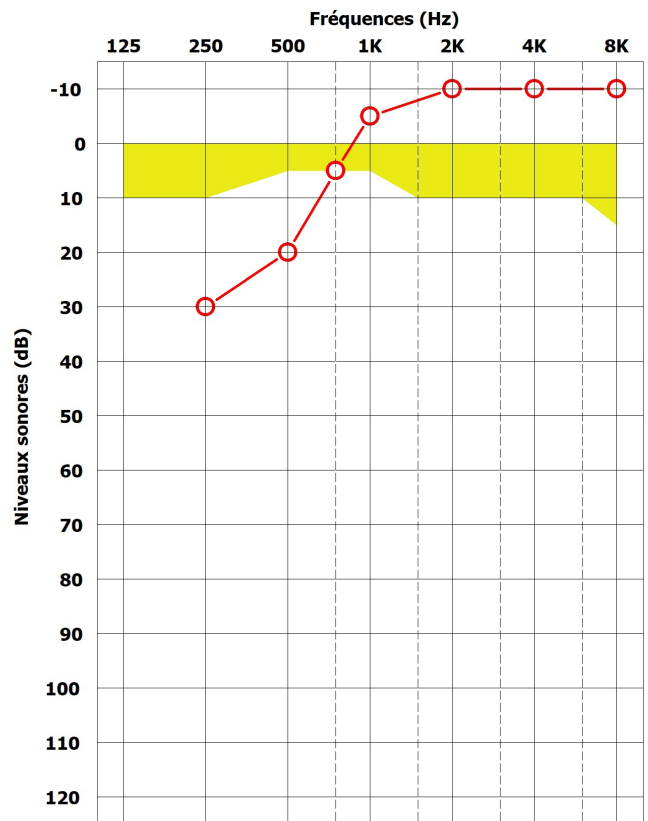

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	-10		-5		10		-10
CA Droit		30	20	5	-5		-10		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes