

MEDVIE

Date du test: 26/03/2024 09:29:38

Durée: 8mn 35s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **KOUROUMA BANGAIY**

Date de naissance 01/03/1988

Age 36

Société CR18


ID 24032609262123496

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

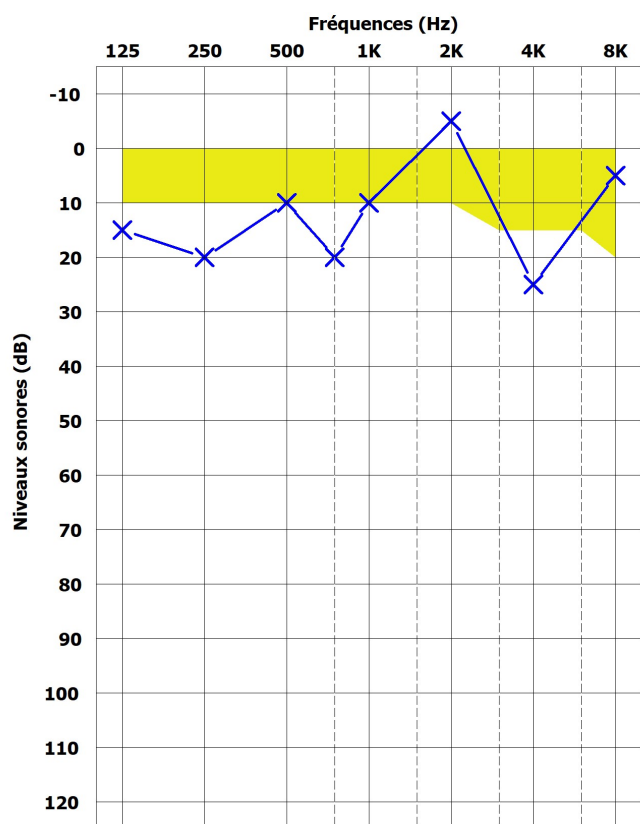

Oreille Gauche

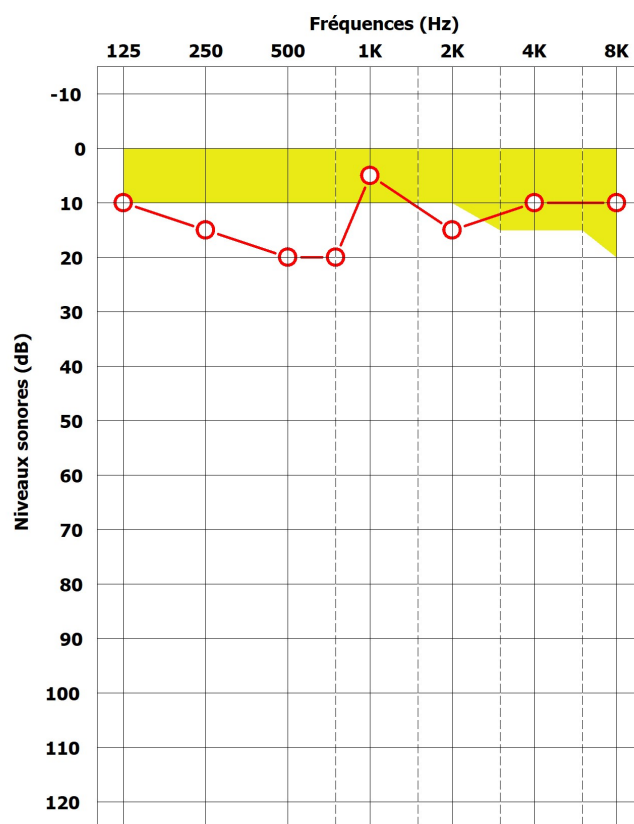

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	10	20	10		-5		25		5
CA Droit	10	15	20	20	5		15		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes