


MEDVIE


Date du test: 16/05/2024 10:22:03
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		FOFANA ANSOU
Date de naissance	01/01/1995	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24051610211391164	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

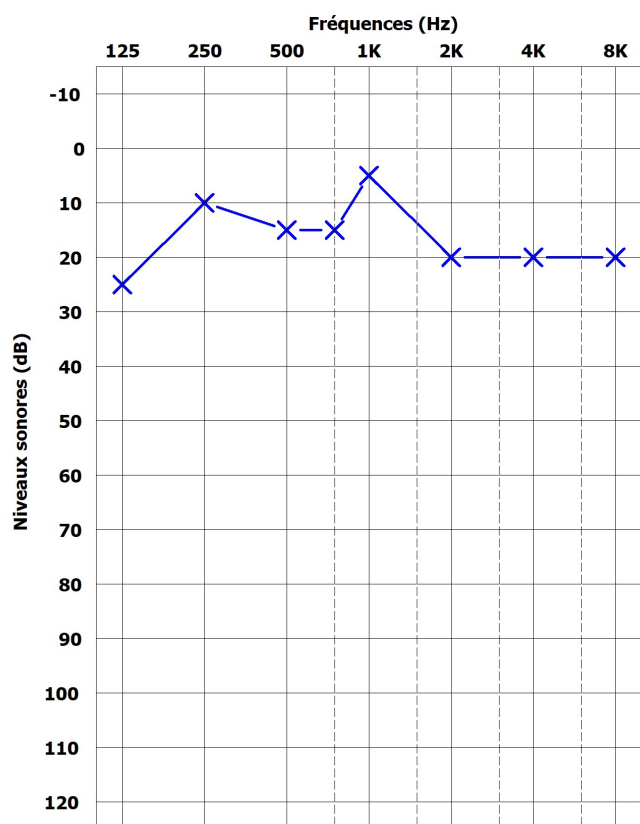

Oreille Gauche

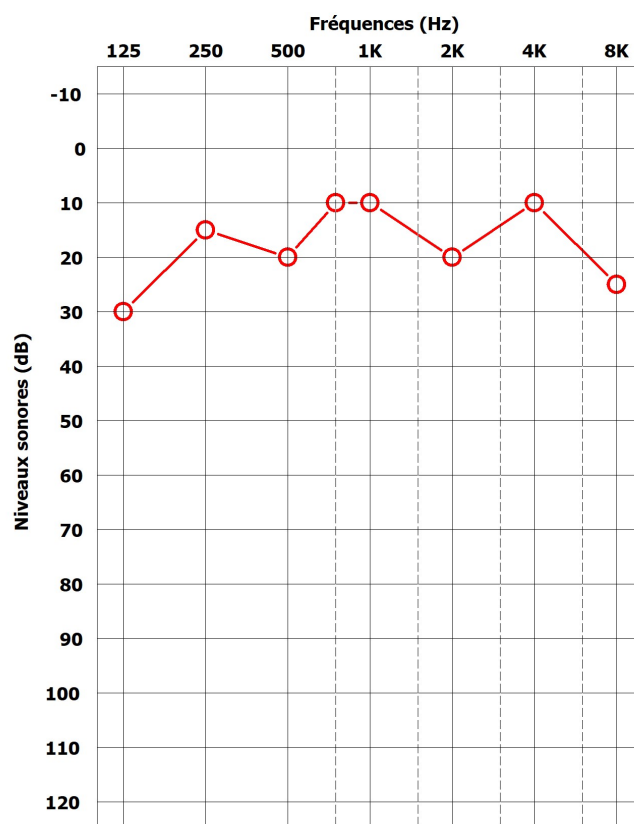

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	15	15	5		20		20		20
CA Droit	30	15	20	10	10		20		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes