


MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 15:29:58
Durée: 8mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE FATOUMATA
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	CR18	
ID	24022915252720785	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

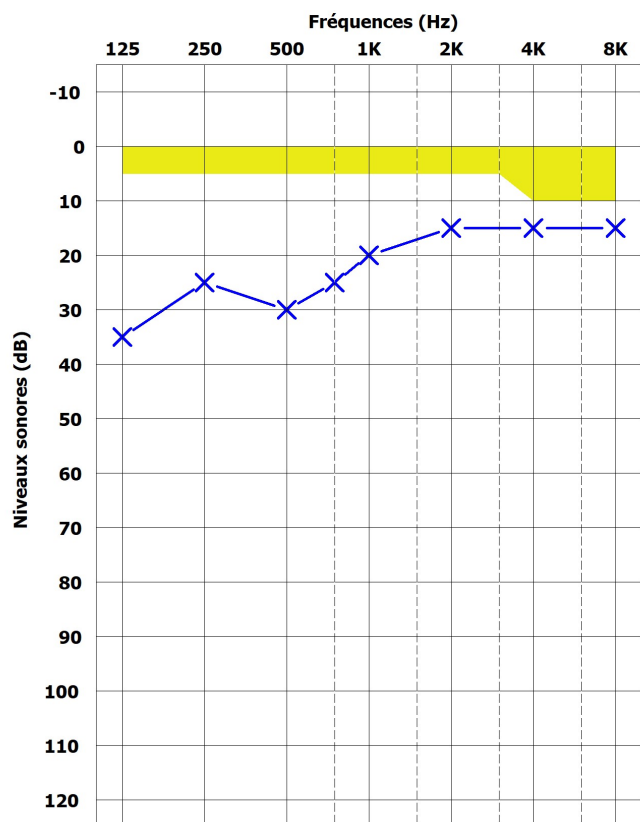

Oreille Gauche

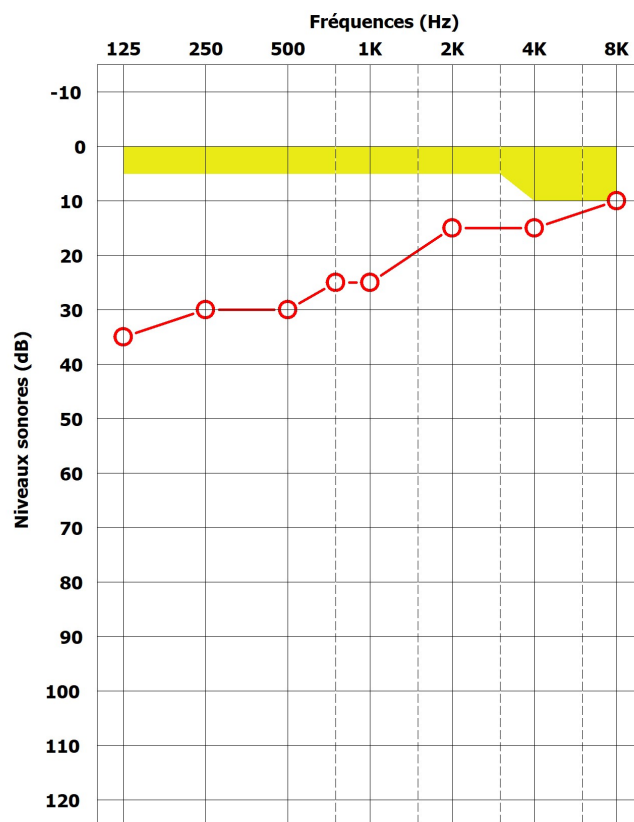

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	30	25	20		15		15		15
CA Droit	35	30	30	25	25		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes