

MEDVIE


Date du test: 02/07/2025 12:15:14

Durée: 4mn 38s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DONG DESHENG
Date de naissance	19/12/1981
Age	43
Société	CR18
ID	25070212115819409

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

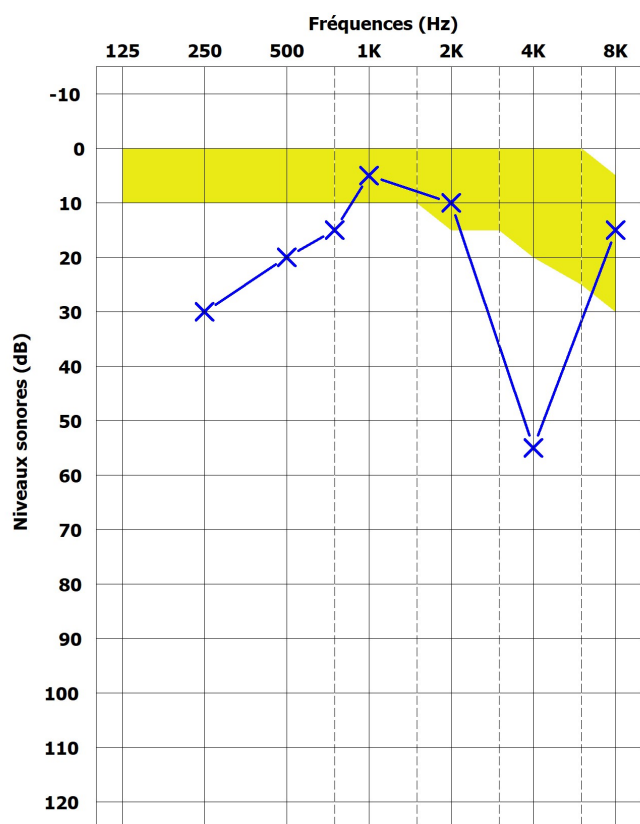

Oreille Gauche

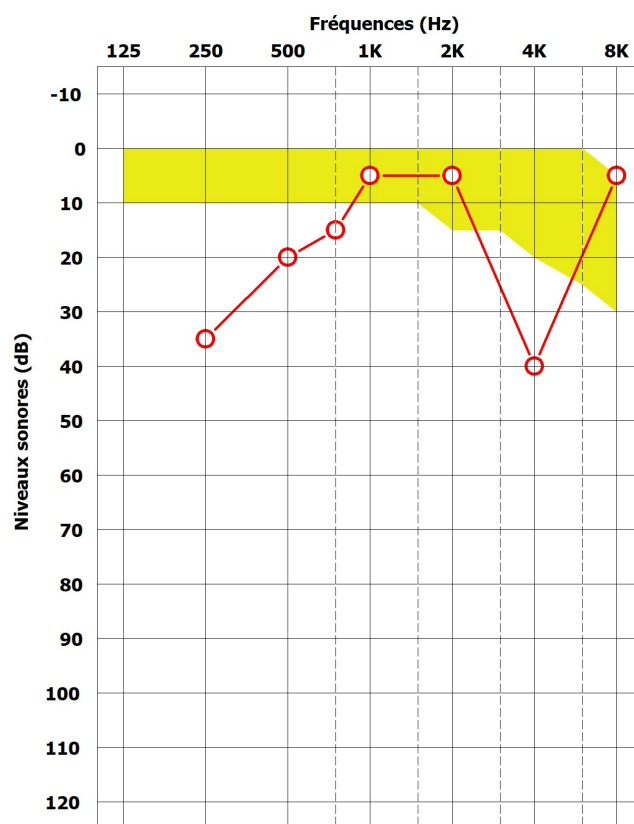

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	15	5		10		55		15
CA Droit		35	20	15	5		5		40		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes