


Données Patient	ZHANG ZHENYONG
Date de naissance	11/09/1977
Age	47
Société	CR18
ID	25032012265845331


MEDVIE

Date du test: 20/03/2025 12:28:23
 Durée: 4mn 33s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

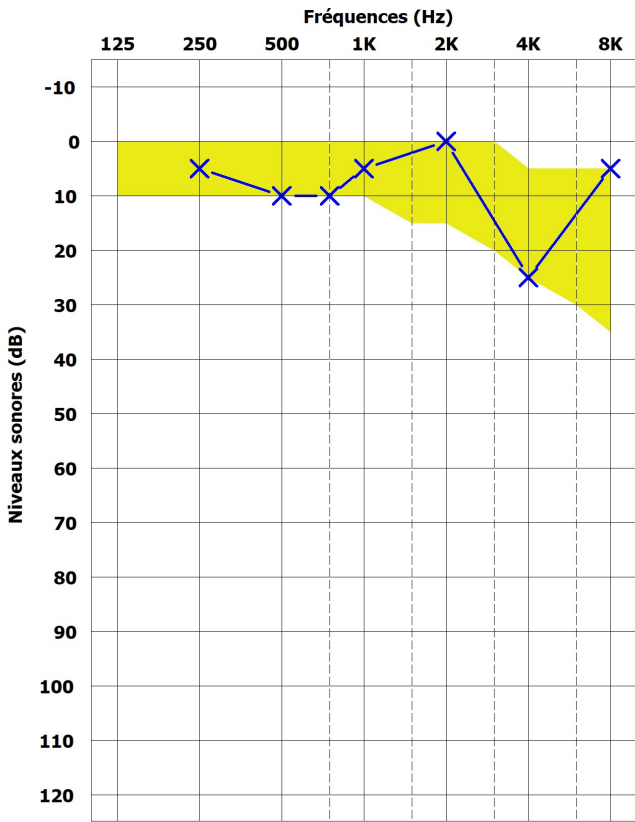

Oreille Gauche

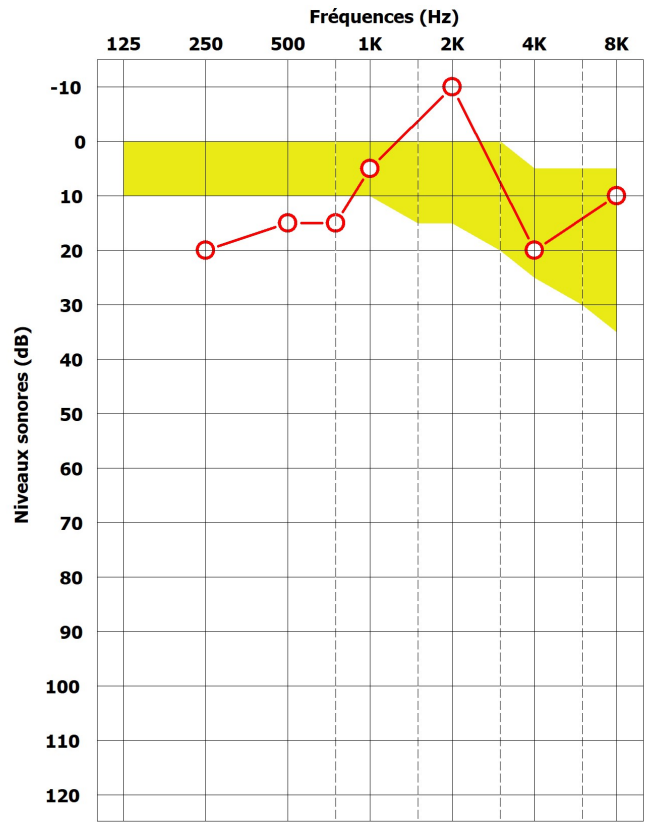

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		0		25		5
CA Droit		20	15	15	5		-10		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes