


MEDVIE


Date du test: 29/04/2025 13:13:51
Durée: 5mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1998
Age	27
Société	CR18
ID	25042913113582085

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

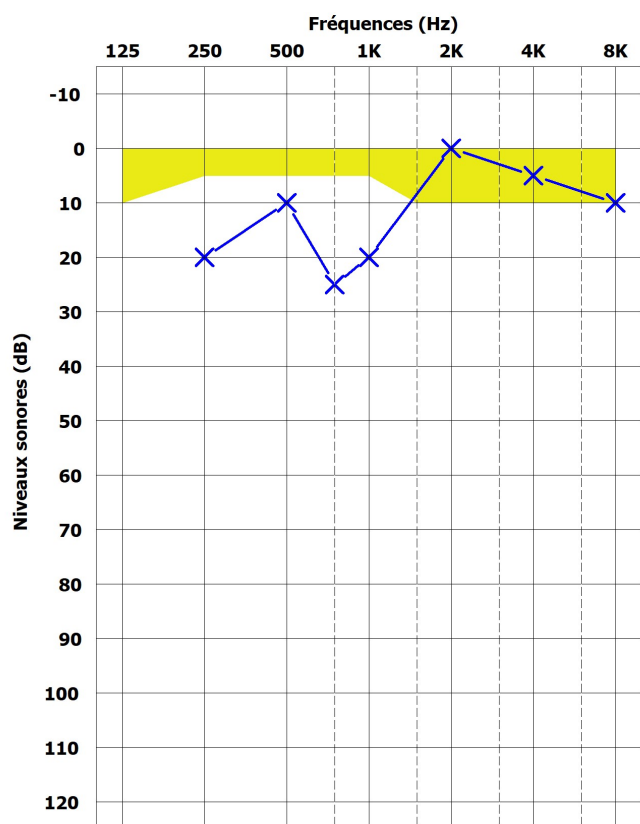

Oreille Gauche

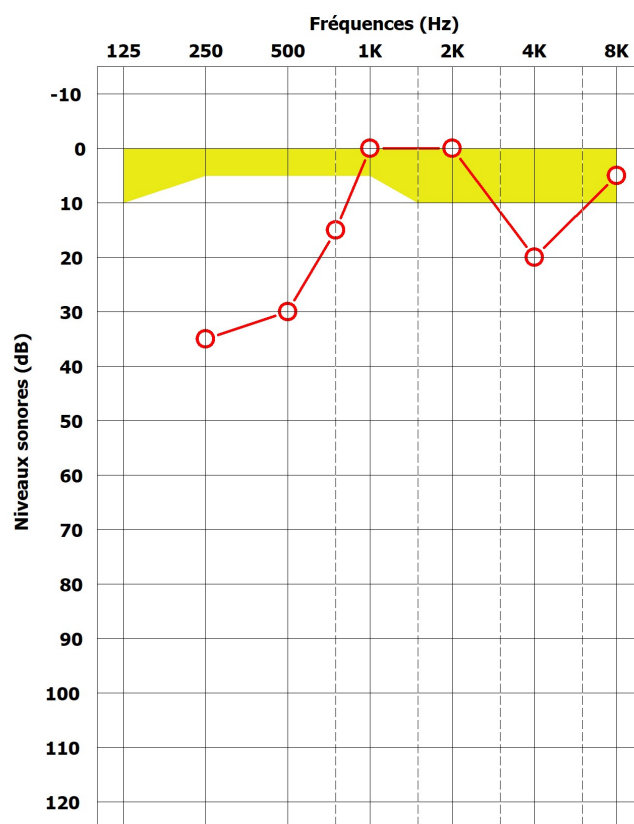

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	10	25	20		0		5		10
CA Droit		35	30	15	0		0		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes