


MEDVIE


Date du test: 25/08/2025 16:45:13
Durée: 5mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE LONCENY	
Date de naissance	25/10/1997
Age	27
Société	CR18
ID	25082516420835277

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

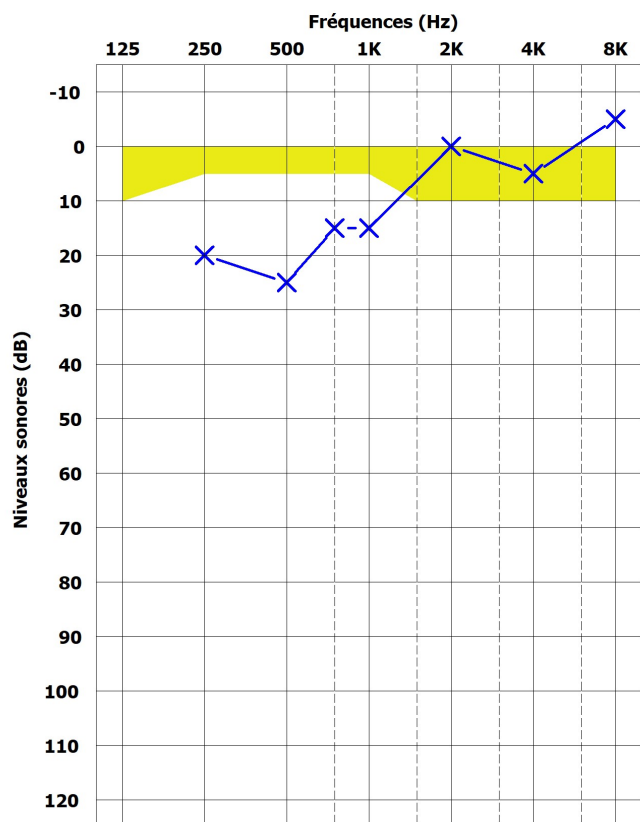

Oreille Gauche

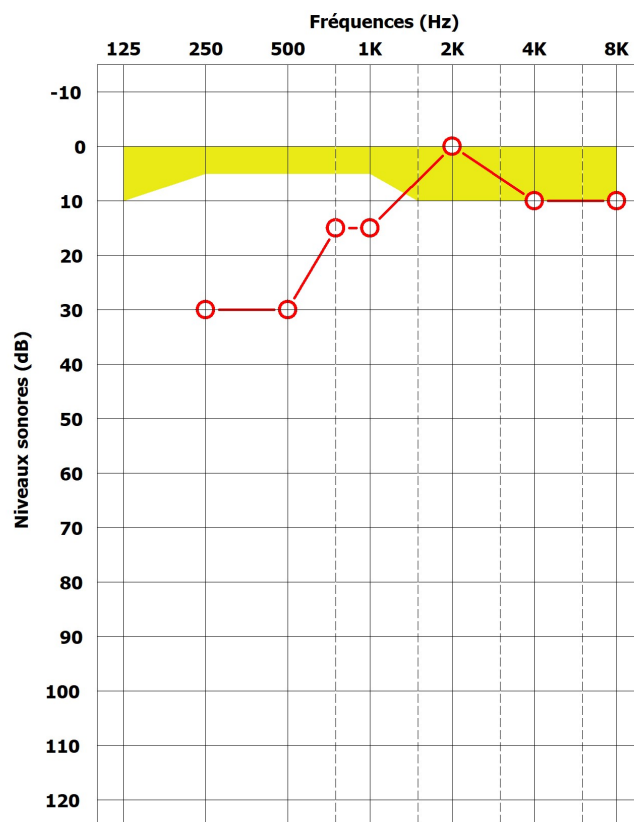

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	15		0		5		-5
CA Droit		30	30	15	15		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes