


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 13:46:31
Durée: 4mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	17/02/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24100113433314902

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

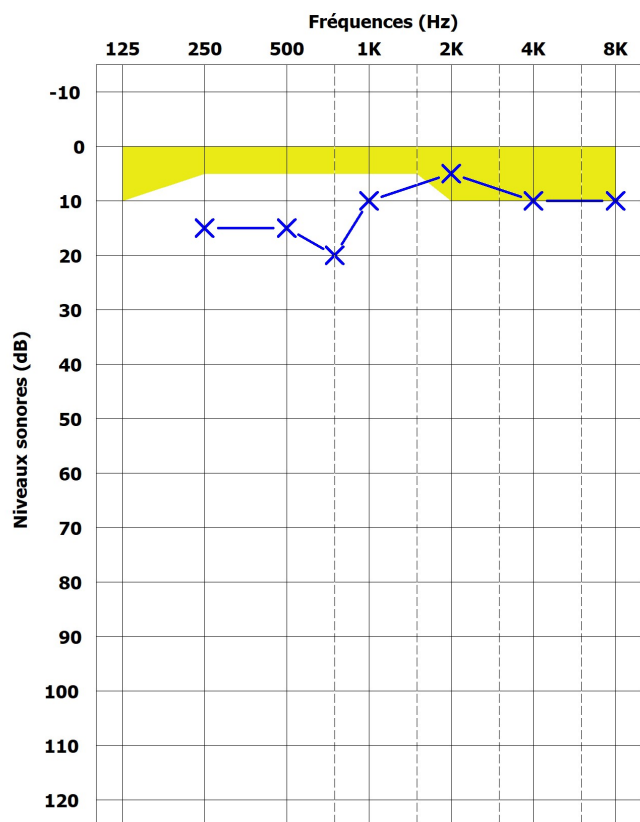

Oreille Gauche

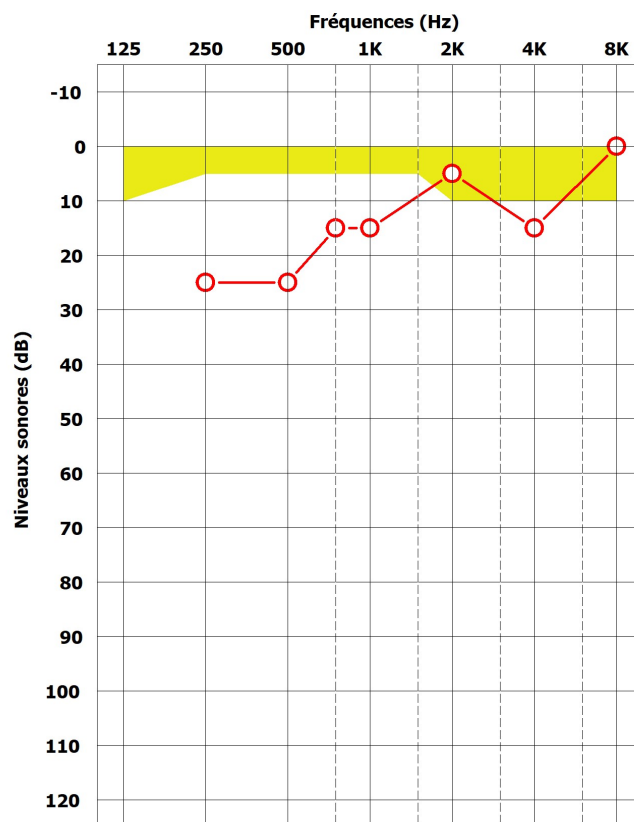

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	20	10		5		10		10
CA Droit		25	25	15	15		5		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes