

Données Patient


SOW MOUSSA

Date de naissance 01/01/1994
Age 30
Société CR18
ID 24050515132027861


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/05/2024 15:17:25
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

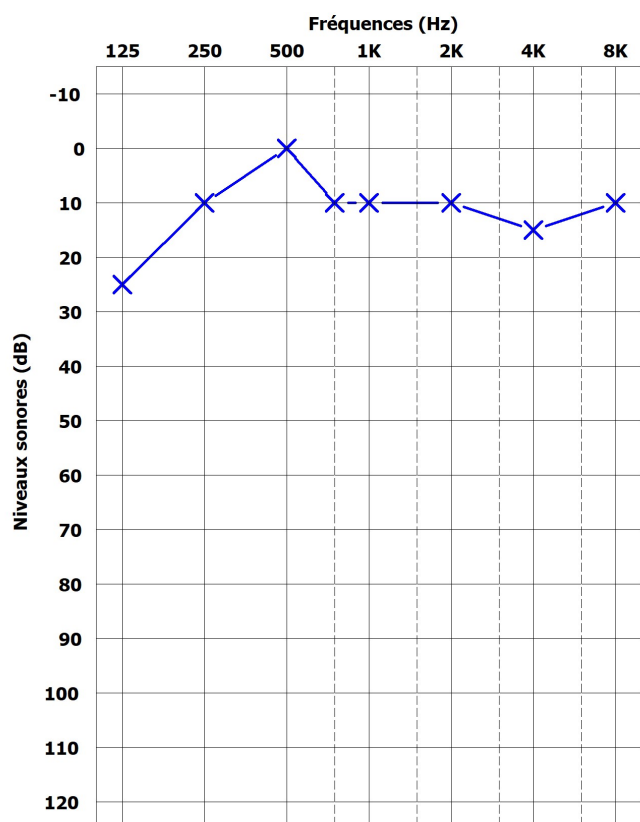

Oreille Gauche

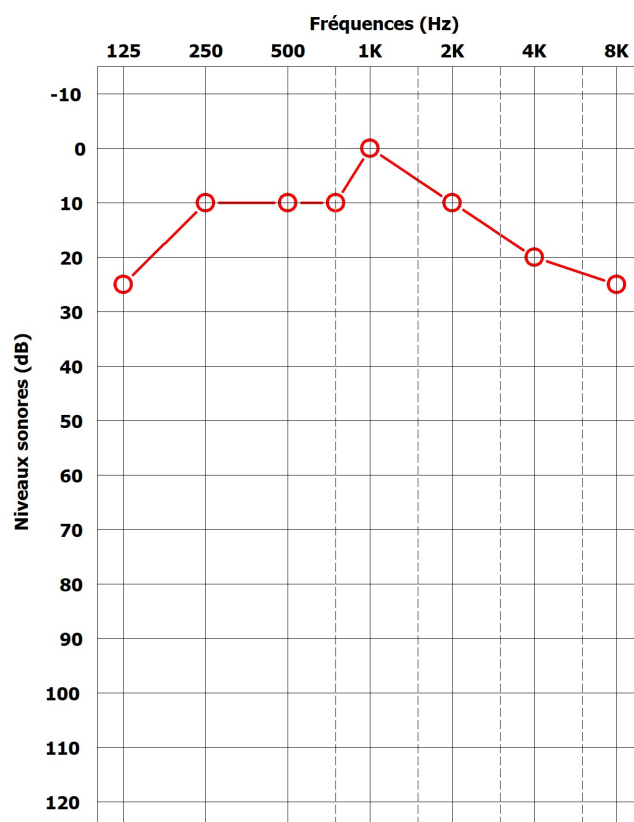

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	0	10	10		10		15		10
CA Droit	25	10	10	10	0		10		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes