


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 14:45:03
Durée: 6mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SIDIBE SOUMAILA	
Date de naissance	17/03/1993
Age	30
Société	CR18
ID	24030414414297135

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

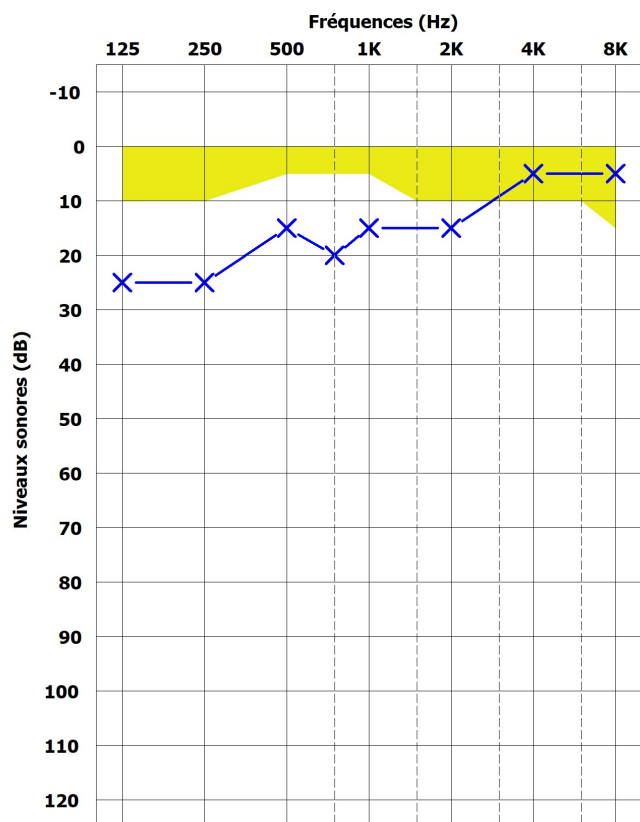

Oreille Gauche

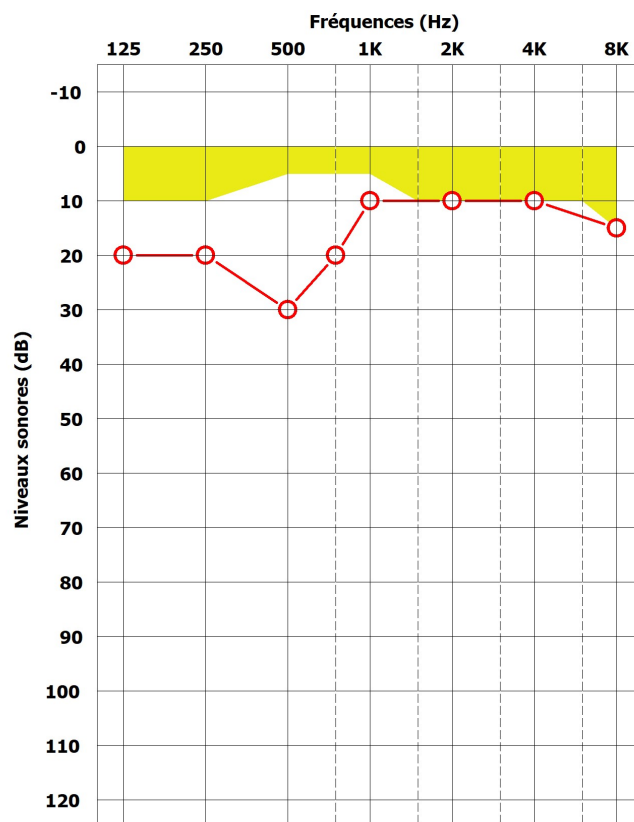

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	15	20	15		15		5		5
CA Droit	20	20	30	20	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes