

MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 11:50:50

Durée: 4mn 30s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF FEREBORY	
Date de naissance	16/08/1981
Age	26
Société	CR18
ID	25030711462249960

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

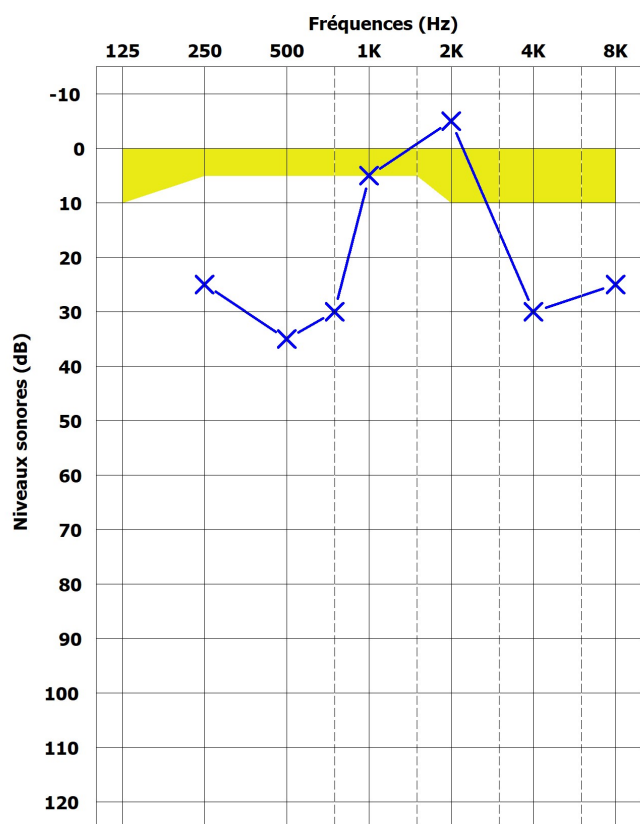

Oreille Gauche

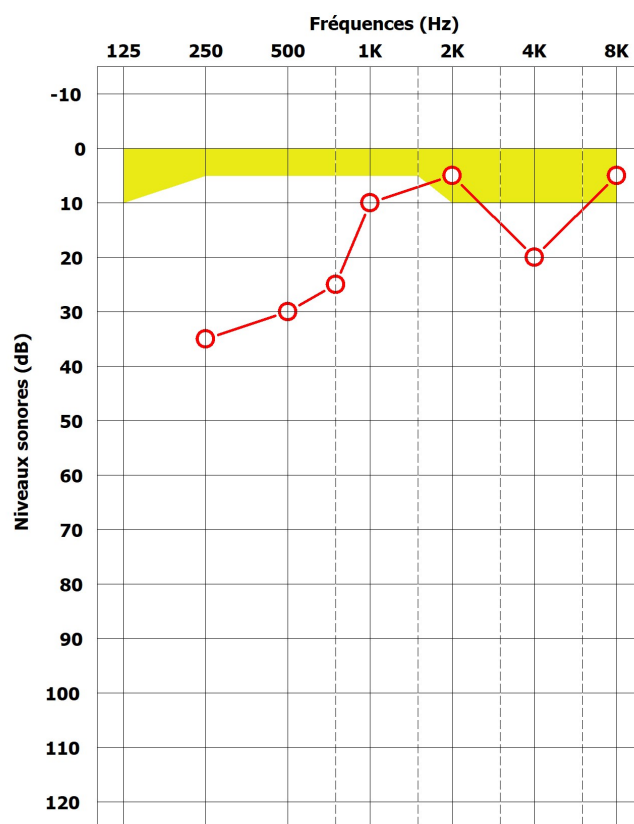

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	30	5		-5		30		25
CA Droit		35	30	25	10		5		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes