

Données Patient


CAMARA AMARA

Date de naissance 30/06/2002
Age 22
Société CR18
ID 25010314472009504


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 03/01/2025 14:49:10
Durée: 2mn 00s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

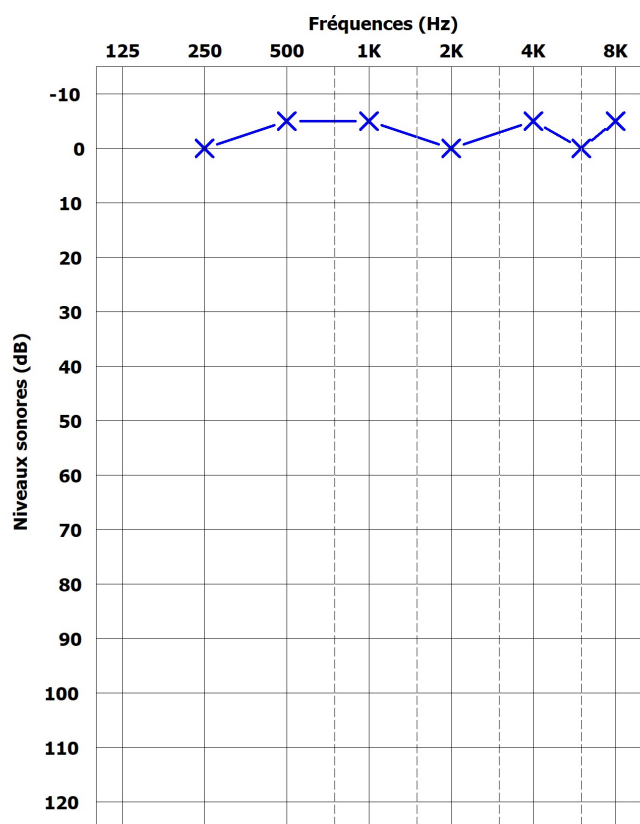

Oreille Gauche

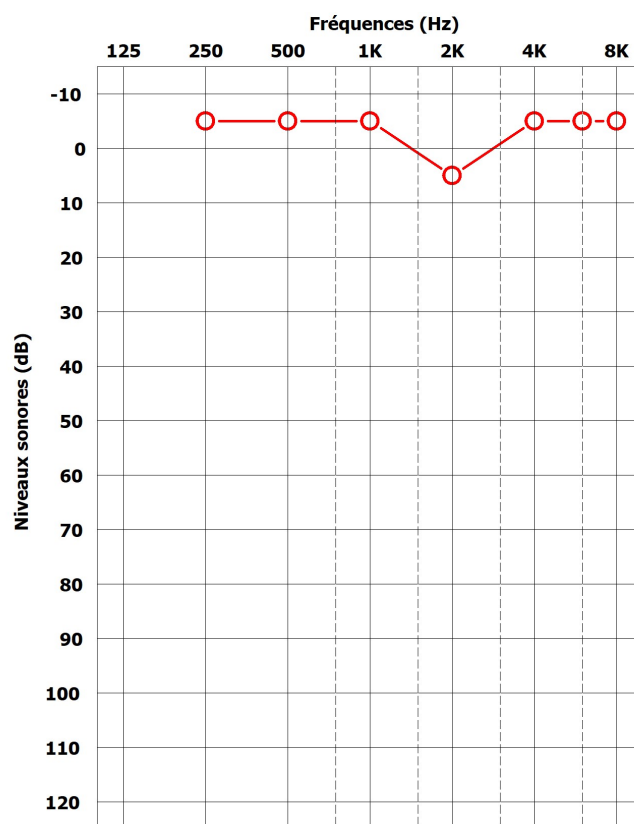

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-5		-5		0		-5	0	-5
CA Droit		-5	-5		-5		5		-5	-5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	-5,0 dB

Notes