
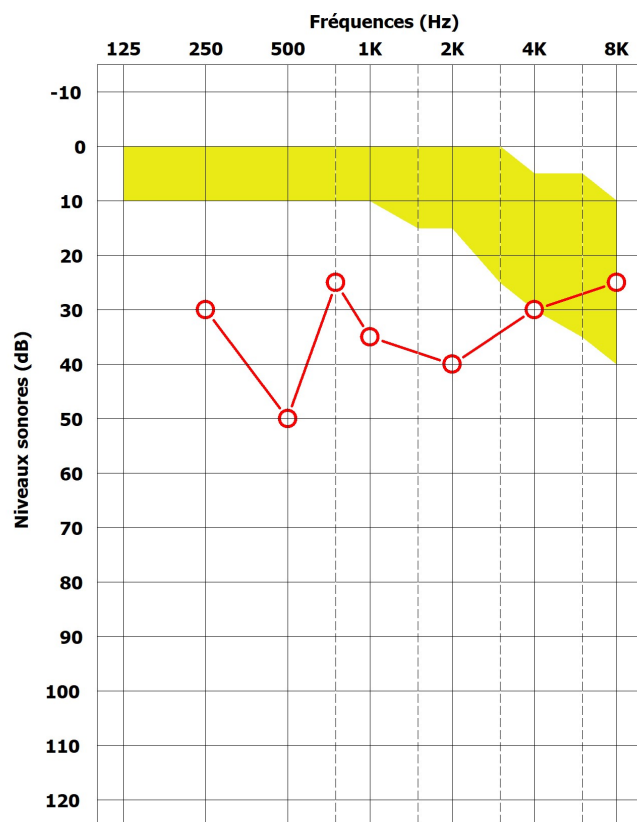


MEDVIE

Date du test: 05/07/2025 13:55:31
Durée: 4mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		YANG ZHENG
Date de naissance	24/03/1975	
Age	50	
Société	CR18	
ID	25070513383316990	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

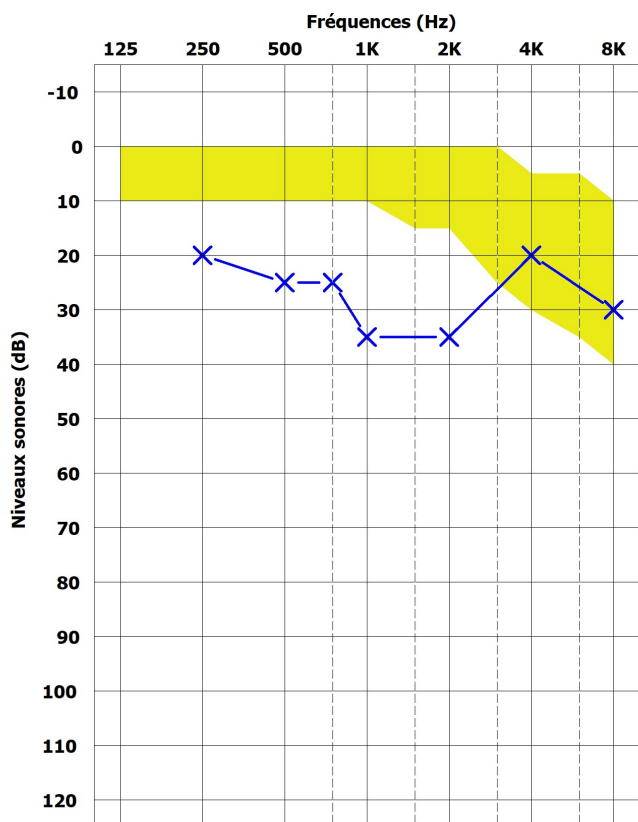

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	35		35		20		30
CA Droit		30	50	25	35		40		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	38,8 dB	---

Notes