


MEDVIE


Date du test: 02/06/2024 13:58:31
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
KOUROUMA SEKOU	
Date de naissance	05/02/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24060213572204570

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

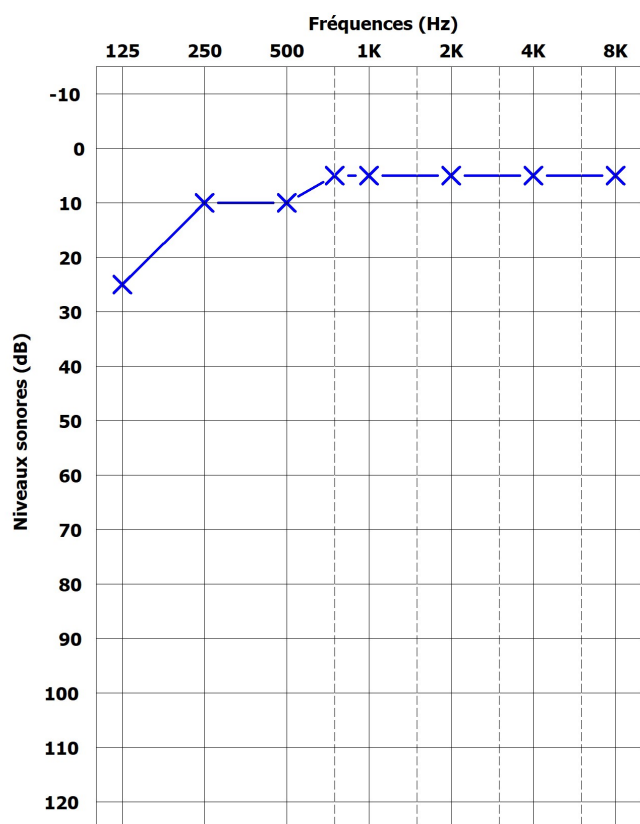

Oreille Gauche

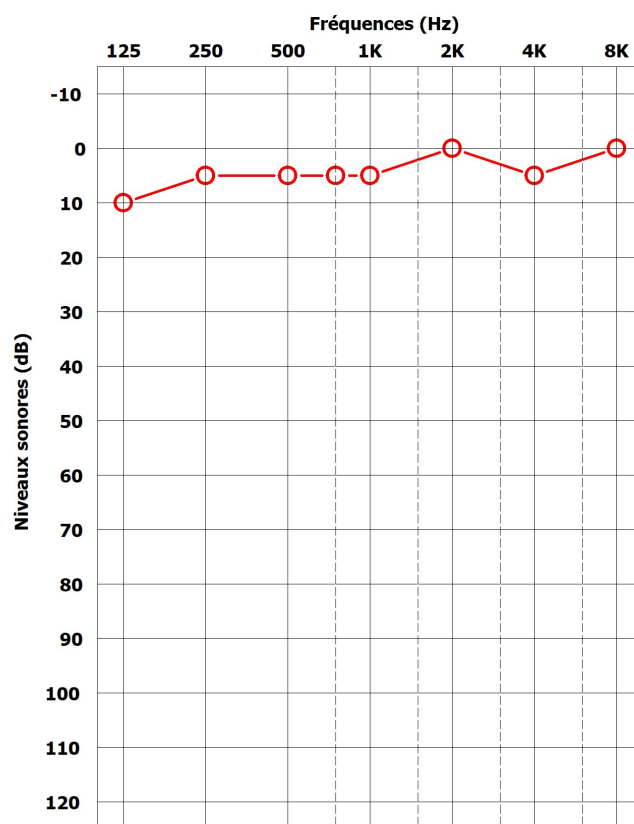

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	10	5	5		5		5		5
CA Droit	10	5	5	5	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes