

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 15:55:55

Durée: 10mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA BAKARY
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24032015534708471

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

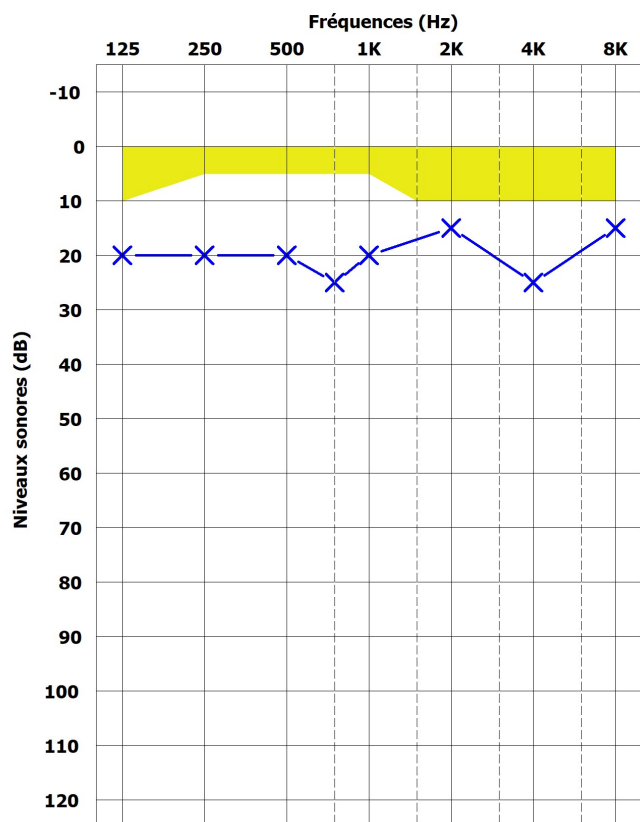

Oreille Gauche

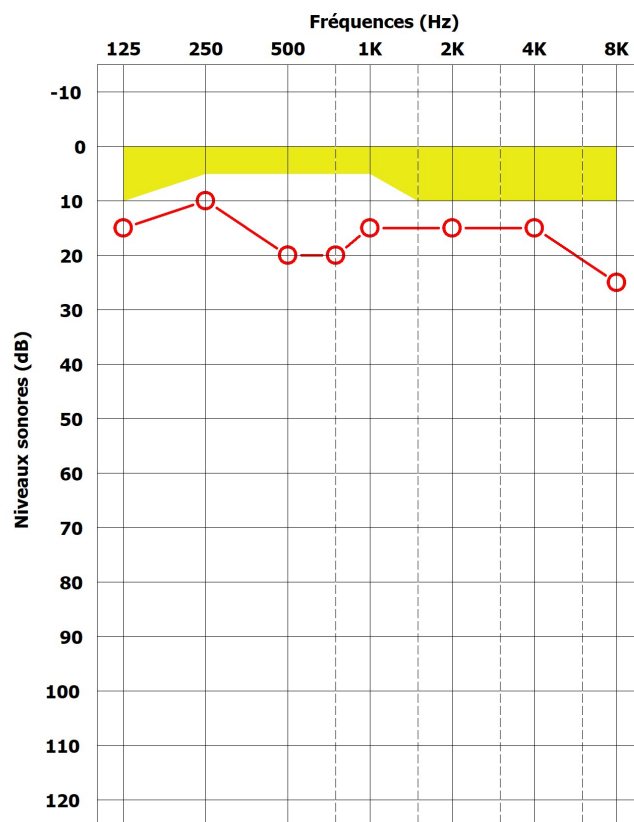

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	25	20		15		25		15
CA Droit	15	10	20	20	15		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes