


MEDVIE


Date du test: 23/04/2024 13:02:33
Durée: 10mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE YAKOUBA	
Date de naissance	03/11/1992
Age	31
Société	CR18
ID	24042312565694235

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

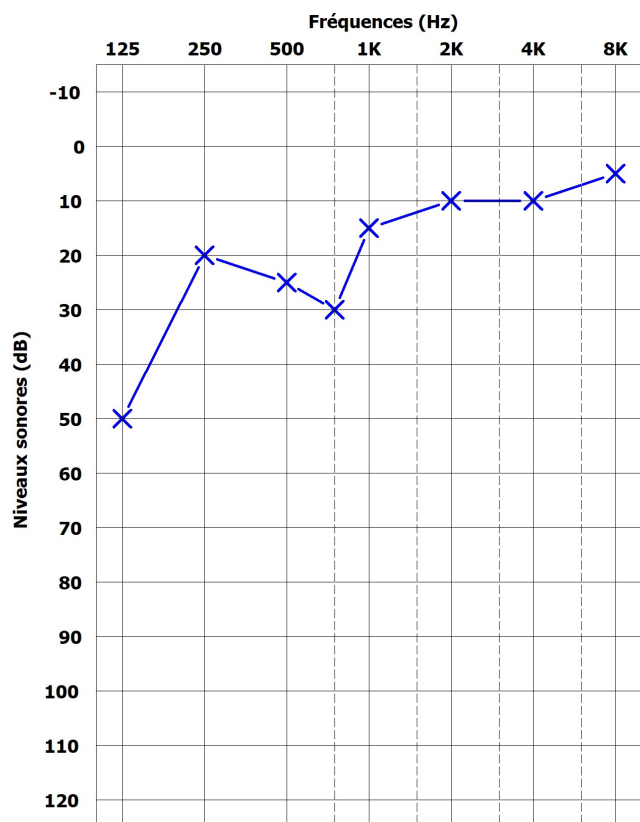

Oreille Gauche

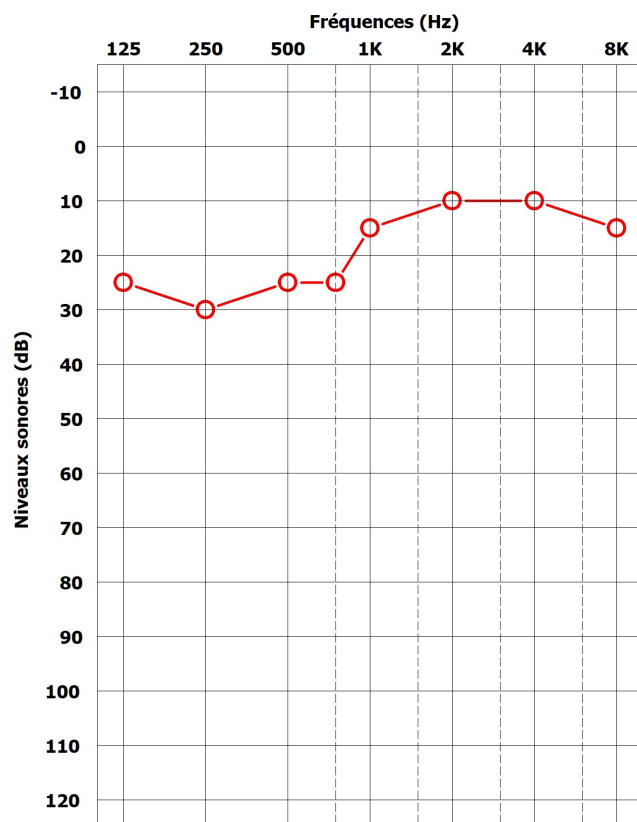

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	20	25	30	15		10		10		5
CA Droit	25	30	25	25	15		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes