

MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 11:30:27

Durée: 5mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		XIAOLIANG ZHU
Date de naissance	07/05/1986	
Age	39	
Société	CR18	
ID	25070411251307490	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

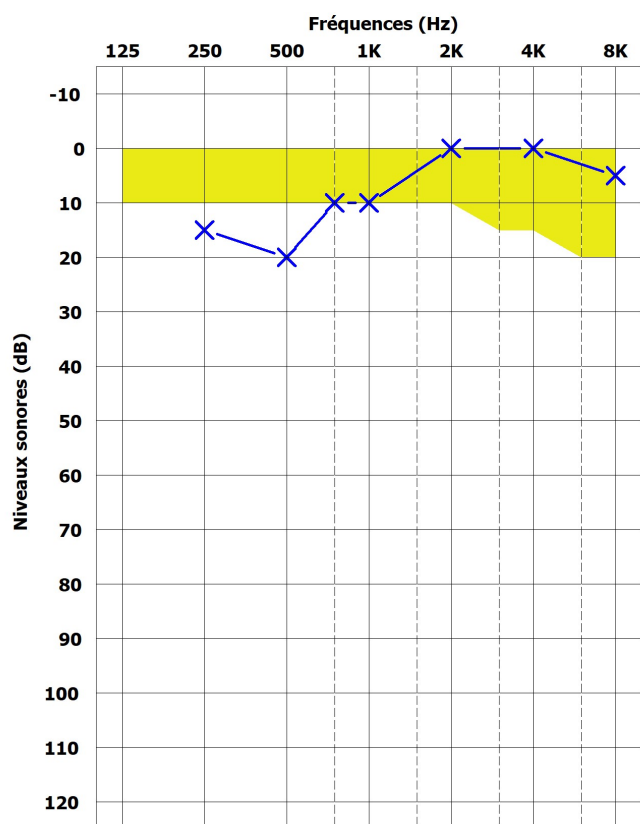

Oreille Gauche

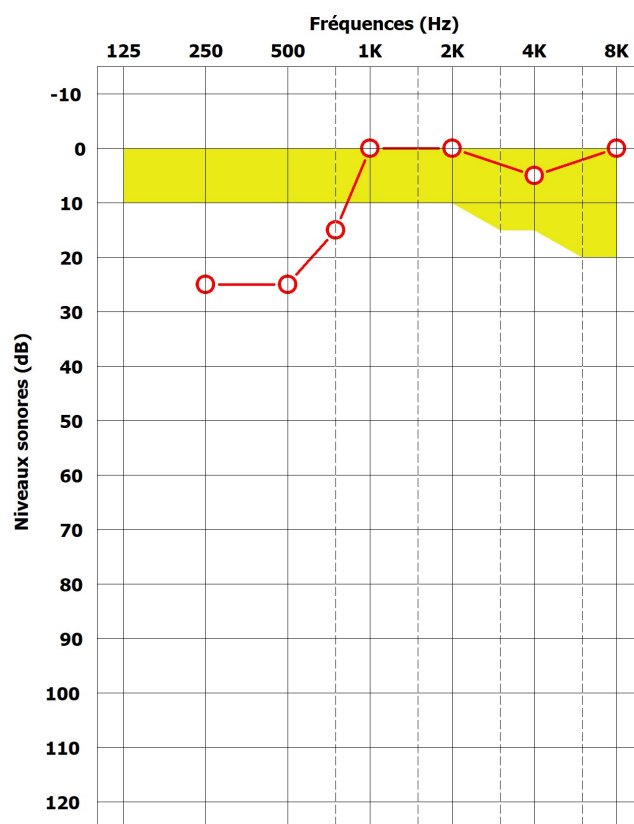

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	10	10		0		0		5
CA Droit		25	25	15	0		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes