


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 12:25:54
Durée: 5mn 22s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BALLO MOUSSA	
Date de naissance	16/03/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24093012193224876

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

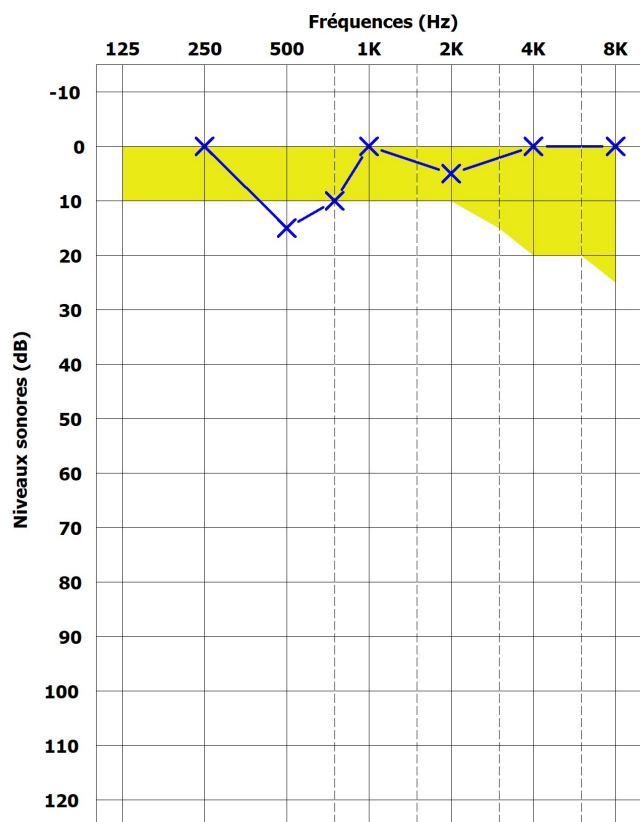

Oreille Gauche

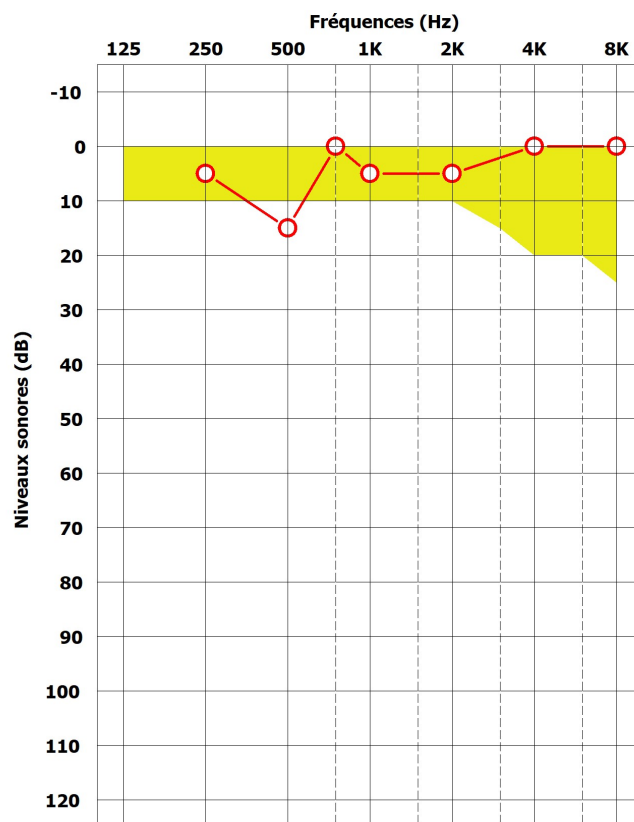

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	10	0		5		0		0
CA Droit		5	15	0	5		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes